	LISTADO DE PERSONAL		
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ		
AREA	NOMBRE	CARGO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
MANTENIMIENTO	LASSO MUÑOZ JORGE WILMER	MANTENIMIENTO / BIOMEDICO	INTERMEDIO
	ESCUADERO RIOS FRANCISCO ALONSO	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	
	RESTREPO OSPINA WILSON ANDRES	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	
	QUINTERO GIRALDO ALEXANDER	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	
	HERNANDEZ GONZALEZ LUIS GERMAN	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	
	GARCIA CAMPUZANO JOSE LUIS	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	
	RAMIREZ LUIS ALFONSO	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	
ACOMPANIAMIENTO A USUARIO	MARIN PEÑA JOSE OMAR	portero/ ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO	DIRECTO
	CANO CASTAÑO FABIO NELSON	portero/ ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO	
	CASTAÑEDA CASTAÑEDA GERMAN	portero/ ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO	
	DIAZ VALENCIA HENRY	portero/ ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO	
	MARIN MARULANDA JOSE HERIBERTO	portero/ ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO	
SERVICIOS GENERALES	ARIAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS GENERALES	DIRECTO
	CARDONA ARROYAVE MARIA ORFANERY	SERVICIOS GENERALES	
	DELGADO VALENCIA BLANCA LUCIA	SERVICIOS GENERALES	
	FLOREZ AGUDELO MARY LUZ	SERVICIOS GENERALES / MEDIO TIEMPO SAN FELIX	
	HIDALGO RAMIREZ LUZ BELLA	SERVICIOS GENERALES	
	OCAMPO RENDÓN LUZ AMPARO	SERVICIOS GENERALES	
	OSORIO LOAIZA AMPARO	SERVICIOS GENERALES	
	QUINTERO GALVIS BIBIANA	SERVICIOS GENERALES	
	AMAYA ARCILA GLORIA NANCY	SERVICIOS GENERALES	
	SANCHEZ ARROYAVE LUISA FERNANDA	SERVICIOS GENERALES	
	ALVAREZ ALZATE MARIA CECILIA	SERVICIOS GENERALES	
TRANSPORTE PACIENTES	VANEGAS RIVERA FERNANDO	TRANSPORTE DE PACIENTES	DIRECTO
		TRANSPORTE DE PACIENTES / MEDIO TIEMPO SAN FELIX	
	RAVE DIAZ JORGE OBDUBER	TRANSPORTE DE PACIENTES	
	CARDONA AGUIRRE MAURICIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	
	RAMIREZ MARIN JUAN PABLO	TRANSPORTE DE PACIENTES	

TR/
DE I

ADMINISTRATIVOS

OSPINA CASTAÑO NESTOR FABIO	TRANSPORTE DE PACIENTES
RIVERA LEIVA RUBEN DARIO	TRANSPORTE DE PACIENTES
AGUDELO OSORIO VALENTINA	AUDITORIA DE CALIDAD
VALENCIA GONZALEZ LINA PAOLA	COORDINADORA SG-SST
DIAZ RESTREPO LUIS GERMAN	COORDINADOR DE CARTERA Y COSTOS
RIOS DUQUE LUIS EDUARDO	COORDINADOR SIAU
RIOS RIOS CRISTIAN CAMILO	COORDINACION / ALMACEN Y MANTENIMIENTO
LONDOÑO RIOS ELIANA MARCELA	COMUNICACIÓN SOCIAL
ZULUAGA VILLEGAS RAFAEL ANTONIO	APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y AL TALENTO HUMANO
CASTAÑO GERMAN DARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / GESTION DOCUMENTAL
GONZALES QUISICUE ROSARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / RECURSO HUMANO
HIGUERA GALVEZ DIANA YANETH	SECRETARIA
PATIÑO RINCÓN VALENTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS
VALENCIA MARIN MONICA MARÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS
LADINO TREJOS OMAR ANDRES	COORDINACION FACTURACIÓN
OSORIO ARREDONDO LUIS NORBEY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FACTURACION CENTRAL
CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION
GOMEZ LOPEZ MARIA CLEMENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / APOYO A COORDINACION DE FACTURACION CENTRAL
GARCÍA AGUIRRE SANDRA MILENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION
HENAO CARDONA DIANA MARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION
MORALES AMAYA MARTHA LILIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION
MARTINEZ BETANCUR ALBA NERY	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION
HERNANDEZ OSORIO CONSUELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / ASIGNACION DE CITAS
CARDONA ECHEVERRY JOHAN SANTIAGO	PLANEACION
LOPEZ VASQUEZ ALEJANDRO	PLANEACION
MORALES AMAYA MARIA ALEJANDRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / COSTOS Y CARTERA
CARMONA DUQUE WILSON DIDIER	GERENTE

INTERMEDIO

ENFERMERIA

GOMEZ ZULUAGA MARIA ALEYDA	ASESORA	YELLOW
RINCON SOTO LIANA PATRICIA	SECRETARIA	
HURTADO BLANDÓN LILIANA PATRICIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
ZULUAGA MARIA YOLANDA	AUXILIAR DE INFORMACION EN SALUD	
GIRADO GOMEZ BLANCA AURORA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ PAGADURIA	
CARMONA CIFUENTES ANA OLIVIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SAN FELIX	
GOMEZ MONTOYA ALVARO OCTAVIO	REVISOR FISCAL	
RAMIREZ OCAMPO DIANA CLEMENCIA	SANEAMIENTO FISCAL	
RUIZ JHOVANY	APOYO CONTROL INTERNO	
MORALES JARAMILLO SANDRA BIBIANA	CONTADORA	
MEDINA MAYA GONZALO	ASESOR JURIDICO	
CUBILLOS SOTO FELIPE HERNANDO	ASESOR JURIDICO	
AGUDELO GALLEGO YULI ANA	AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA	
AGUDELO GARCÍA FRANCIA ELENA	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	
ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	
ALZATE RAMÍREZ JENNY PAOLA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	
AMAYA AMAYA YENNNY ALEXANDRA	AUX ENFERMERIA / AUX LABORATORIO	
ARIAS VALENCIA CLAUDIA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	
BOTERO CARDONA MERY (paso de urg a cons a paritr del	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	
CARDONA GOMEZ PAULA MARIANA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	
CARDONA GONZALES DIANA CAROLINA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	
CASTAÑEDA DUQUE ALBA JANNETH	AUX ENFERMERIA / P Y P	
CASTAÑO QUICENO MARIA NORA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	
CORRALES HERNÁNDEZ MARIANA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	
FLOREZ AGUDELO DANIELA	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	
GALLEGO PATIÑO PAULA ANDREA (paso de 3° a urg a par	AUX ENFERMERIA / P Y P - AMBULANCIA	
GARCIA GIL LUCY YANED	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	
GARCÍA GIL SORANGIE	AUX ENFERMERIA / P Y P	
GAVIRIA HERNANDEZ ISLENY	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	
GÓMEZ MEJÍA LUCY EDILEN	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	
HERRERA OSORIO MANUELA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	
LASCARRO MEJÍA HEIDY JOHANNA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	
MARIN CARDONA YESICA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	

AUX DE ENFERE	MUÑOZ HERNANDEZ LINA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	DIRECTO
	MURILLO REYES DEIBY SANTIAGO	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	
	NARANJO ALZATE MONICA CONSTANZA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	
	OSORIO GÓMEZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	
	OSORIO PEREZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	
	OSORIO PEREZ MARTHA CECILIA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	
	PATIÑO MEJÍA MARIA ISABEL	AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA	
	QUINTERO CEBALLOS DIANA PAOLA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	
	QUINTERO DIAZ DANIELA	AUX ENFERMERIA / P Y P	
	RAMIREZ MORENO ANGELA VIVIANA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	
	VALENCIA OROZCO ESTELA	AUX ENFERMERIA / P Y P	
	OROZCO LUZ ADRIANA (paso a partir del 16 a 3°)	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	
	CASTRILLON VASQUEZ PAOLA ANDREA	AUX ENFERMERIA / P Y P	
	VALENCIA MARULANDA ESTEBAN	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	
	VELEZ SIERRA JHESIKA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / P Y P	
	VICTORIA MOSQUERA TATIANA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	
	CANO MONTES ESTEFANÍA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	
	GRANADA CAÑÓN MANUELA	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	
	MEJIA GOMEZ ARLEDY	AUX ENFERMERIA / P Y P	
	ALZATE GIRALDO ALBA LUCIA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	
	HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA ELSY	AUX ENFERMERIA / AISLAMIENTO	
	ALCANTARA RAMOS KAREN SHIRLEY	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	
	JHOANA JIMENA GONZALES	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	
ALVAREZ ORDONOÑEZ ISABEL CRISTINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI		
LONDOÑO RESTREPO EDISON	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI		
RAYOS X	PACHECO BRACHE MIGUEL DE JESÚS	TECNOLOGO EN RAYOS X	DIRECTO
	RUIZ ZAPATA DIANA MILENA	TECNOLOGA EN RAYOS X	
FARMACIA	RIOS GALLEGO DIANA LUCIA	AUX DE FARMACIA	INTERMEDIO
	LONDOÑO GONZALEZ ALEJANDRA	QUIMICA FARMACEUTICA	
	LONDOÑO GONZALEZ ALEJANDRA	QUIMICA FARMACEUTICA	
	ARANGO RAMIREZ CLAUDIA YOLIMA	AUX DE FARMACIA	
ENERAL	AGUDELO SALAZAR NESTOR RAUL	MEDICO GENERAL / COORDINADOR	DIRECTO
	ARIAS PATIÑO ANA RUBIELA	MEDICO GENERAL COLPOSCOPISTA	
	CORDEQUE LOZANO MARIA FRANCISCA	MEDICO GENERAL / UCI	

MEDICOS G	GUERRA ORTIZ FRANCISCO JOSE	MEDICO GENERAL	DIRECTO
	LOPEZ TAMAYO JUAN JOSE	MEDICO GENERAL	
	RAIGOSA ARANGO MARIA CRISTINA	MEDICO GENERAL	
	RIOS CARVAJALINO ISABELLA	MEDICO GENERAL	
	CAJAS MUÑOZ GERARDO ANDRES	MEDICO GENERAL	
ENFERMERAS	MAYA AGUDELO XIOMARA	ENFERMERA / URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA	DIRECTO
	RIOS ORTIZ YULIMAR	ENFERMERA / P Y P - SAN FELIX	
	OCAMPO OSORIO DANIELA	ENFERMERA / UCI	
	AGUDELO FERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA	ENFERMERA / UCI	
	GOMEZ MONTOYA NATALIA	ENFERMERA / UCI	
	VELÁSQUEZ CASTRILLÓN MARISOL	ENFERMERA / COORDINACION - CIRUGIA Y HOSPITALIZACION	
ODONTOLOGIA	HOLGUIN GOMEZ ISABELLA	ODONTOLOGA /	DIRECTO
	MARULANDA GARCIA STEFANIA	AUX DE ODONTOLOGIA	
	ACEVEDO LONDOÑO JUAN CAMILO	ODONTOLOGO / COORDINACION	
LABORATORIO	GIRALDO NARANJO SARA JEIN	BACTERIOLOGA / LABORATORIO	DIRECTO
	ARIAS MURILLO JULIANNA CAROLINA	BACTERIOLOGA / COORDINACIÓN	
ESPECIALISTAS	GONZALEZ MEDINA PAULA ANDREA	PSICOLOGA	DIRECTO
	AGUIRRE SANCHEZ LEIDY	FISIOTERAPEUTA	
	VELEZ DUQUE LEIDY JOHANA	FISIOTERAPEUTA / UCI	
	GARZON HERRERA EDNA LUCIA	FISIOTERAPEUTA / UCI	
	MARIN SIPAGAUTA JUAN SEBASTIAN	FISIOTERAPEUTA / UCI	
	BEDOYA GOMEZ VALERIA	FISIOTERAPEUTA / UCI	
	PEREZ IGLESIAS LUIS AUGUSTO	INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	
	AGUDELO FERNADEZ JUAN CARLOS	ORTOPEDISTA	
	STEER MARTINEZ JUAN FELIPE	ORTOPEDISTA	
	GURROLA CHACON RAUL ARMANDO	ORTOPEDISTA	
	ROSALES LORA JOHN CARLOS	CIRUJANO GENERAL	
	MENDOZA GOMEZ MIKE LEON	CIRUJANO GENERAL	
	MARTINEZ VALLEJO WILLIAN JOSE	CIRUJANO GENERAL	
	SALDOVAL PEREZ RAUL ANTONIO	ANESTESIOLOGO	
	LOPEZ SANCHEZ AMILCAR	ANESTESIOLOGO	
	GONZALEZ GOMEZ DANIELA	GINECO OBSTETRA	
DAVILA ARIAS LILIANA DEL SOCORRO	GINECO OBSTETRA		

MEDICOS RURAL	CHICA GUTIERREZ JOSE EDGAR	MEDICINA FAMILIAR	
	SERNA GRANADA CARLOS ANDRES	MEDICO INTERNISTA	
	MEJIA GUTIERREZ DARIO	MEDICO INTERNISTA	
	RODRIGUEZ BERMUDEZ JAIME ANDRES	MEDICO INTERNISTA	
	GALLEGO VILLARRIAGA INGRID CAROLINA	OTORRINOLARINGOLOGA	
	BOTELLO JAIMES JHON JAIRO	INTENSIVISTA	
	BELTRAN NOVOA JUAN JOSE	MEDICO RURAL	DIRECTO
	CORDOBA ARANGO LAURA	MEDICO RURAL	
	TRIVIÑO CASTRO SILVIA PAOLA	MEDICO RURAL	
	MONTEMIRANDA MONTENEGRO JUAN JOSE	MEDICO RURAL	
	GUEVARA BOTERO KATTERINE	MEDICO RURAL	
	MORENO OSPINA ANGELA MARIA	MEDICO RURAL	
	CARDONA OSPINA VALERIA	MEDICO RURAL	

IDENTIFICACION F
Comercial. Equipamento
LUDOS

Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

INSTRUCCIONES DE USO

GUANTE DE LATEX QUIRÚRGICO CON Y SIN POLVO

Ámbito de uso: Los guantes quirúrgicos con polvo se utilizan para la barrera biológica contra la contaminación de las manos de los usuarios que pretenden obtener contacto con el paciente y para evitar la contaminación entre el paciente y el examinador para un solo uso.

Instrucciones: Precaución: - Este producto está hecho de látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas.

Almacenamiento: - Evitar la luz solar directa, mantener en un lugar fresco y seco.

Vida útil: 5 años en la fecha de fabricación.

DECLARACION DE EMPAQUE

GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES CON POLVO Y SIN POLVO

Caja dispensadora / Caja interior:

Material utilizado para la caja dispensadora : Cartón de revés gris de 450g
Dimensión de caja dispensadora : 220mm x 130mm x 225mm
Tipo de impresión : Impresión a 1 color y barniz

Caja de cartón:

Material utilizado para la caja de cartón : 275 / 275 / una estría
Dimensión de la caja dispensadora : 540mm x 450mm x 235mm
Tipo de impresión : Impresión a 1 color

Bolsa:

Material utilizado para la bolsa : Medicoat GL 60/3g y Papel PE 40/18g
Dimensión para la bolsa : 130 mm x 203 mm
Tipo de Impresión : Impresión 1-2 colores

- a) 1 par de guantes(1 izquierda y 1 derecha) por envoltura interior
- b) 1 envoltura interior por bolsa
- c) 50 bolsas por dispensador
- d) 8 dispensadores por caja

TG MEDICAL SDN. BHD

Este producto tiene una validez de 5 años desde la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento está impresa en las cajas.

GUANTES NEWMEK

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Los guantes quirúrgicos de látex en polvo (palma textura)

SECCIÓN I: Descripción del producto

1. Tipo 1 guante de látex quirúrgico, en polvo, estéril
1. 2 Material Natural High Grade látex de caucho
1. 3 Color Natural
1. Diseño y 4 de funciones específicas de la mano, los dedos curvados, palma textura, puño con reborde
1. 5 Polvo dentro de almidón de maíz absorbible USP 1
1. 6 Condiciones de Almacenamiento Los guantes mantendrán sus propiedades si se guardan en un estado seco. Evite la luz solar directa.
1. 7 Estabilidad Los guantes deben tener vida útil de 5 años desde la fecha de fabricación.
1. 8 estilo de embalaje 1 par (1 izquierda y 1 derecha) de guantes por envoltura interior. 1 envoltorio interno por cada bolsa. 50 bolsas por liberador. 8 dispensadores por caja.
1. Marcado 9 Tamaño El tamaño de los guantes se marcará en la casilla de verificación en cada caja con tinta negro.

Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

SECCIÓN II: Requisitos de funcionamiento

(Plan de Muestreo - ISO 2859 individual normal)

AQL: 1.5

#	CARACTERISTICAS	NIVEL DE INSPECCION	NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE	NORMA TECNICA APLICATIVA
2.1	Dimensiones	S2	4.0	ASTM D3577-09e1
2.2	Propiedades físicas	S2	4.0	ASTM D3577-09e1
2.3	Ausencia de poros (TEST DE AGUA ESTANCADA)	G1	1.0	ASTM D3577-09e1
2.4	Los defectos visuales: (I) Mayor Visual (II) Menor Visual Basic	G1	2.5 4.0	PRACTICA IN HOUSE
2.5	Embalaje defectuoso: (i) Regulado (ii) Visual (iii) Críticos (incl. Guantes conteo)	G1 G1 S2	** 4.0 4.0	PRACTICA IN HOUSE
2.6	Cantidad de polvo	N=2	N/A	ASTM D3577-09 ^{e1} ASTM D6124-06 (2011)
2.7	Esterilización	^	N/A	^US Pharmacopeia

** Inaceptable en cualquier nivel

SECCIÓN III: ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

3.1 DIMENSIONES

DESCRIPCION	TAMAÑO	ESTANDAR
Longitud (mm)	Todos los tamaños	Min 280
Ancho de palma (mm)	5.5	72 +/- 4
	6.0	77 +/- 5
	6.5	83 +/- 5
	7.0	89 +/- 5
	7.5	95 +/- 5


Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

	8.0	102 +/- 6
	8.5	108 +/- 6
	9.0	114 +/- 6
Espesor (mm) * Pared simple	Todos los tamaños	Dedo: 0,15 +/- 0,02 (Valor típico: 0,16 - 0,17) Palma: 0,13 +/- 0,02 (Valor típico 0,13 - 0,14) Puño: 0,12 +/- 0,02 (Valor típico: 0.11 - 0.12)

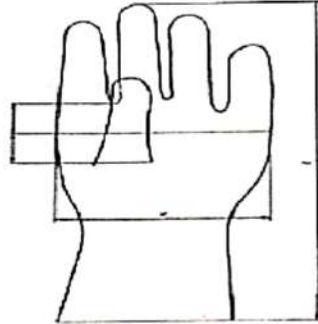

3.2 Propiedades Físicas

Descripción	Estándar	
	Antes de uso	Después de uso
Elongación y descanso (%)	Min. 750 (Tipo de valor: 750 - 900)	Min. 560 (Tipo de valor: 560 - 800)
Resistencia a la tracción (MPa)	Min. 24 (Tipo de valor: 24 - 30)	Min. 18 (Tipo de valor: 18 - 25)

3.3 Ausencia de poros

El tamaño de la muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras se determinarán de acuerdo al plan de muestreo ISO 2859-1 individual normal mediante la

Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD


inspección y el nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño.


3.4 Los defectos visuales

El tamaño de la muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras, tanto para defectos mayores y menores serán determinados de acuerdo a la norma ISO 2859-1 del plan de muestreo individual normal el uso de Inspección y nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño.

3.5 Defectos de envasado

El tamaño de la muestra y el número permisible de productos no conformes en las muestras de los defectos de envasado de regulación, visuales y críticos se determinarán de acuerdo al plan de muestreo ISO 2859-1 individual normal el uso de Inspección y nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño (guantes Contando = 50 pares por el dispensador).

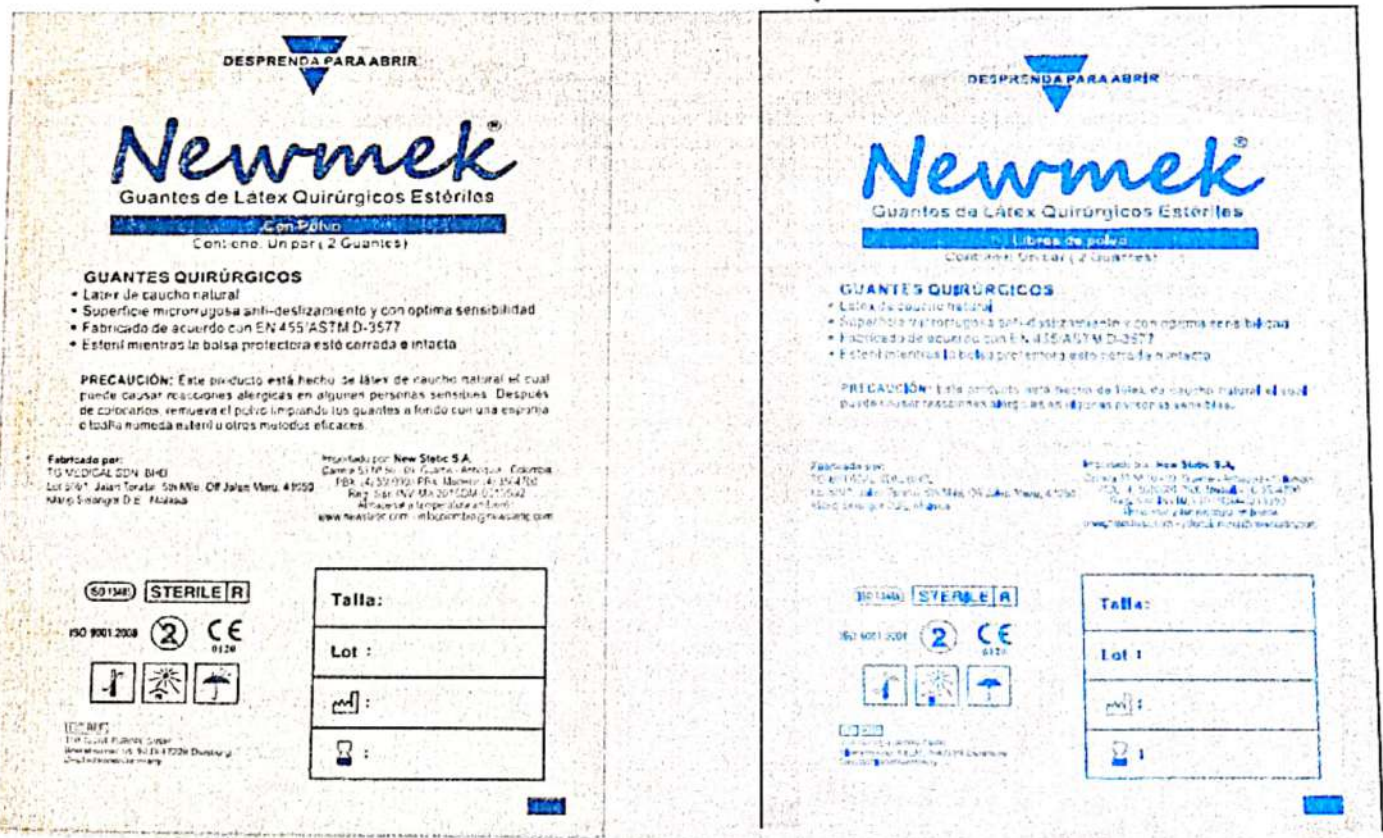



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015035333 DE 7 de Septiembre de 2015

Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO


QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMÁTICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARÁ EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A
PRODUCTO: GUANTES QUIRÚRGICOS ESTERILIZADOS (GUANTES CON POLVO Y SIN POLVO) - GUANTES DE LATEX QUIRÚRGICOS ESTERILES (CON POLVO Y SIN POLVO)
MARCA: NEWMEK
REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2015DM-0013592
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA
FABRICANTE(S): TG MEDICAL SDN BHD CON DOMICILIO EN MALASIA
IMPORTADOR(ES): PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA
ACONDICIONADOR(ES): PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA
TIPO DE DISPOSITIVO: NO INVASIVO
RIESGO: IIA
COMPOSICIÓN: LATEX DE CAUCHO NATURAL, ZDBC, ZDEC, ÓXIDO DE ZINC, FENOL IMPEDIDO POLIMÉRICO, AZUFRE, DIOXIDO DE TITANIO.
USOS: UTILIZADOS COMO BARRERA BIOLÓGICA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE LAS MANOS DEL USUARIO, ESTÁN PREVISTOS PARA EL CONTACTO CON EL PACIENTE Y PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN ENTRE EL PACIENTE Y EL EXAMINADOR, PARA UN SOLO USO, GARANTIZAN CONDICIONES SANITARIAS DE HOSPITAL MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL PACIENTE A LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA. TAMBIÉN SIRVEN PARA PROTEGER A LOS PROFESIONALES, TRABAJADORES DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES A TRAVÉS DEL CONTACTO CON FLUIDOS CORPORALES.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: CAJA DISPENSADORA, CON 50 BOLSAS X DISPENSADOR, BOLSA DE PAPEL INDIVIDUAL, SELLADA, EMPACADA, CON 1 PAR DE GUANTES (1 IZQUIERDA Y 1 DERECHA), 8 DISPENSADORES POR CAJA.
VIDA ÚTIL: 5 AÑOS
EXPEDIENTE NO.: 20098138
RADICACIÓN NO.: 2015115887
FECHA DE RADICACIÓN: 04 09 2015

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.





República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015035333 DE 7 de Septiembre de 2015

Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: kpuertac, Técnico: jparraa Revisó: Cordina_varios

Firma válida


Digitally signed by ELKIN
HERNAN OTALVARO
CIFUENTES
Date: 2015.09.08
08:06:33 -04'
Reason: Firma
Location: Bogota, CO

Página 2 de 2

Referencia
CARETA ANTIFLUX 25


Descripción de la pieza
Careta cuya pantalla es fabricada en PET CAL.25.

Aplicación
Careta de protección antiruidos y anti objetos extraños, con potencialidad de ser utilizada en sectores industriales y de la salud.

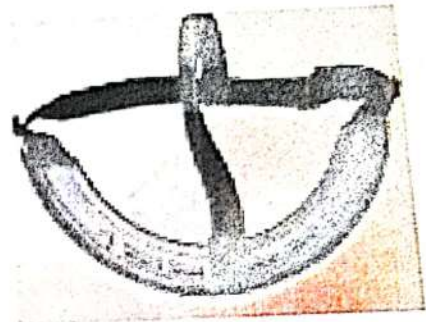

Recomendaciones antes del Uso
Se sugiere realizar pruebas según sea la aplicación a la que será sometida el producto. El uso del producto determinará la vida útil del mismo.

Condiciones de almacenamiento
La careta de protección no debe ser expuesta a fuentes de calor cercanas ni rayos solares de manera directa, adicional debe estar protegido de la humedad y evitar contaminación con material particulado como polvo. Para su almacenamiento debe estar cubierto con bolsas y dentro de la caja, tal como se entrega de fábrica.

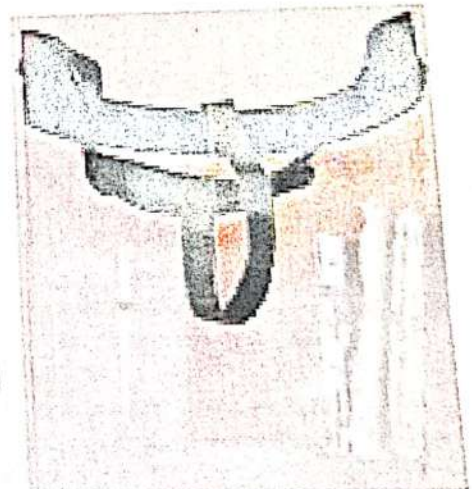

Especificaciones de unidad de empaque
Bolsa plástica en PEBD, caja individual de cartón (12 caretas por caja) y caja master de cartón (9-6 cajas individuales).

General

El comportamiento real del producto, dado a su aplicabilidad, podrá ser evidenciado en las instalaciones del cliente.



DESCRIPCION:

- Guantes de exploración desechables, elaborados a base de látex natural, sin polvo y/o ligeramente polvosados con polvo biodegradable.
- Guantes ambidiestros, máxima comodidad y flexibilidad.
- No estériles
- Multiempaque, con dispensador que garantiza la integridad del producto.
- Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes.
- Aséptico, hipotérmico, atóxico.

CARACTERISTICAS

- Elaborados de 100% Látex natural, sin polvo y/o ligeramente lubricados con polvo biodegradable calidad USP.
- Resistente a la elongación.
- Color: natural
- De forma anatómica, zona de agarre texturada y con superficie lisa, tersa y uniforme antideslizante.
- Cumple con las pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las Normas Internacionales Vigentes: ISO 11193, EN 455-2, EN 455-3 y ASTM D 3578-01

INDICACIONES

- Para realizar exámenes, procedimientos médicos y limpieza de pacientes.
- Demás procedimientos clínico hospitalarios.
- En caso de manipulación de material contaminado y para realización de pruebas de laboratorio.

VENTAJAS

- Fácil uso
- Hipotérmico
- Ajuste exacto y suave
- Fuerte y durable
- Libre de olores desagradables.

DIMENSIONES


Propiedad	Talla	Estándar	Color	Textura
Longitud (mm)	XS	Mínimo 220 mm	Natural (Todas las tallas: XS, S, M, L, XL)	Tersa, lisa, antideslizante (Todas las Tallas: XS, S, M, L, XL)
	S			
	M	Mínimo 230		
	L			
	XL	Mínimo 240		
Ancho de Palma (mm)	XS	70 ± 10	Natural (Todas las tallas: XS, S, M, L, XL)	Tersa, lisa, antideslizante (Todas las Tallas: XS, S, M, L, XL)
	S	80 ± 10		
	M	95 ± 10		
	L	111 ± 10		
	XL	113 ± 10		
Espesor (mm)	Todas las tallas	Deco: 0.06 Palma: 0.08 Bocamanga: 0.08		

FICHA TECNICA PRECISION CARE



Protección de manos en tratamientos médicos no estériles.
Fabricados con los estándares de la norma ASTM D3578.

- Fabricados en látex natural.
- Alta resistencia a la tracción y abrasión.
- Anatómicos manga larga.
- Revestimiento de almidón que reduce la fricción sobre la piel y permite un ajuste perfecto y confortable.
- Color natural.
- Borde enrollado.

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Blanco - Negro - Azul - Verde

2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Polipropileno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza, localizando una en la coronilla y otra en la nuca



CALDAS MEDICAS SAS

890.806.147-3

Carrera 24 # 47-74

ventas@caldasmedicas.com - servicioalcliente@caldasmedicas.com

Telefono:8859134 - Telefax :8859878

Manizales-Caldas

Manizales, Julio 10 de 2.020

Señores
HOSPITAL FELIPE SUAREZ
Salamina - Caldas

REF:

ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX Basic A
SERIAL #	560042-M20107690015


RECIBIDO	
Nombre:	
Cedula:	
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

Atentamente,

CECILIA GOMEZ GOMEZ.

Gerente

EQUIPOS MEDICOS - LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS
MATERIALES QUIRÚRGICOS - ODONTOLÓGICOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustándola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, No use el respirador

3.2. Condiciones de Uso

PARÁMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 ⁶ partículas /ft ³ TLV-TWA 0,05 mg/m ³
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	> 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H ₂ O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H ₂ O

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolapsamiento, que une las telas evitando que se separen.

**FICHA TÉCNICA**

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4

FLI-18

VERSIÓN
N° 04FECHA DE VIGENCIA
2018

Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inoloro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	Hermeticidad	Nitta

7. PRESENTACIÓN

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.


Elaborado y Revisado

**GERMAN SUAREZ S.
DIRECTOR DE CALIDAD**

N° Revisión: 04 Fecha: 03 Noviembre de 2018

Guantes de Examen Desechables

Página Web: www.protexsa.com.co E-mail: correspondencia@protexsa.com.co

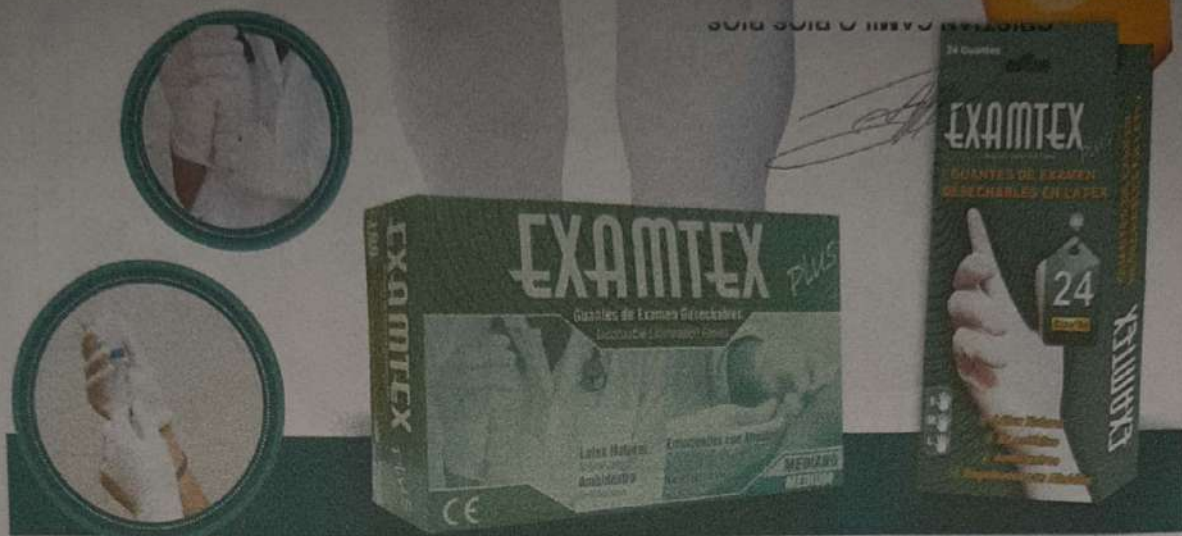

ISO9002



CE



FICHA TECNICA

- Guantes AQL 1.5
- Elaborados en látex natural.
- Ambidextros, cómodos y de fácil postura.
- No estériles
- Pre-entalcados con almidón.
- Con orillo
- Empaque: Dispensador : 100 unidades por peso- Caja: 10 dispensadores
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades Físicas según ASTM D3578: (00)-(01)

ESTANDARES DE CALIDAD

- Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002.
- Cumple y/o excede los estándares ASTM 3578-95
- Cumple y/o excede los estándares europeos EN 455-1/2/3.
- Cumple y/o excede Norma Técnica Colombiana NTC 4277.
- Auditado por SGS.
- Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP. ▪ Plan de Muestreo ISO 2851

PROPIEDADES FISICAS	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO		ESTANDARES ASTM D 3578 (01)		AQL	Nivel de Inspección
	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO		
Fuerza Tensil	Min.21MPa.	Min.16MPa.	Min.14MPa.	Min.14MPa.	Huecos 1.5 Apariencia 2.5 Dimensiones 4.0	S-4 S-4 S-2
Elongación	Min.700%	Min.500%	Min.650%	Min.500%		

Caja x 100un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD	Caja x 24un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD
	1	2	3		1	2	3
	770 727036 3646	770 727036 3653	770 727036 3660		770 727036 7450	770 727036 7460	770 727036 7477
	770 727036 3677				770 727036 7484		



www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax. (57-1) 8267750

Parque Industrial San José - Rodeña 10 v 11 - Manz. C. Km. 4 Via Funza Siberia. Cundinamarca. Colom

GUANTES DE VINILO DESECHABLES

VINYL DISPOSABLE GLOVES



ESTANDARES DE CALIDAD

- Cumple los Estándares ASTM D5250-00
- Cumple los Estándares Europeos EN 455-00

INFORMACION TECNICA

- Ambidextros, cómodos y fáciles de poner y quitar.
- Sin talco
- Terminación con orillo.
- No estériles.
- Fabricado de Vinilo (Cloruro de Polivinilo), Grado: FPC DNV2P.
- Doble capa de PVC/ PU que provee una mayor seguridad.
- Forma de Empaque: Dispensador 100 unidades por peso en Caja
- de 10 dispensadores.
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades físicas y dimensiones según ASTM D5250-99, ASTM D5250-00

BENEFICIOS

- Súper flexibles y livianos.
- Libre de olor, resultado de una formulación especial.
- Buen agarre en superficies pegajosas.
- Otorga una solución alternativa a las personas que son alérgicas al látex.
- Usos habituales: Limpieza, manipulación de alimentos, hobbies, procedimientos odontológicos, inspección de mercancías y control de calidad.

ASPECTOS	NUESTRO PRODUCTO	ASTM D5250 (99)
FUERZA TENSIL	Min. 9 Mpa	Min. 9 MPa
ELONGACION	300%	300%

DIMENSIONES	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO					ASTM D5250 (00)				
	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL
LARGO	230mm					230mm				
ANCHO		86+5	95+5	109+5	115+5		76+5	88+5	102+5	114+5
CALIBRE mm	DEDOS		PALMA	PUÑO		DEDOS		PALMA	PUÑO	
	0.16+0.03		0.15+0.03	0.12+0.03		0.05 min.		0.08 min.	-	




www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750
Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 - Manz.C Km.4 Vía Funza Siberia. Cundinamarca, Colombia

Producto descartable, diseñado con los mejores estándares de calidad, con una alta capacidad de resistencia al paso de microorganismos y tecnología antilíquido. Brinda confort con características higiénicas y antialérgicas.

Uso: Procedimientos quirúrgicos realizados por el personal médico y paramédico del medio hospitalario. (producto médico de clase I)



Nº	ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1	1122	Batón americano con refuerzo en manga y pecho	1
2	976	Toalla para secado de manos	1
3	2546	Indicador de esterilización	1

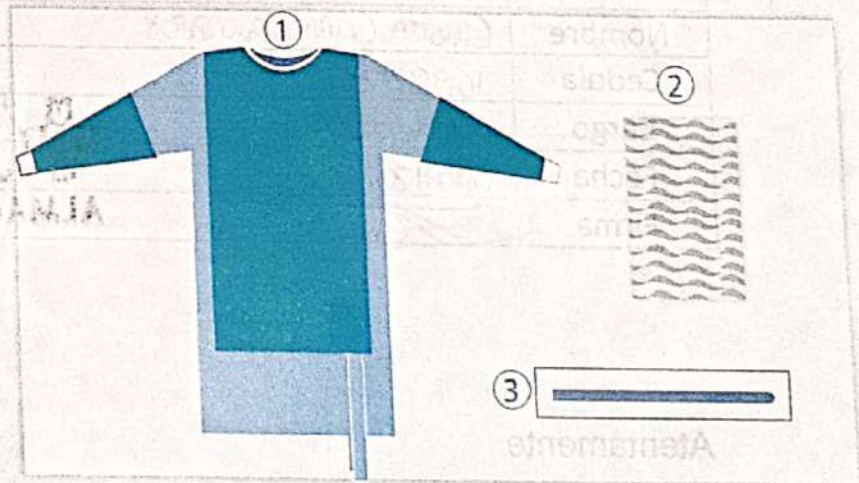

- Adhesivo
- SMS
- Refuerzo
- Absorbente impermeable
- Polietileno azul
- Polietileno transparente
- Tela laminada



CALDAS MEDICAS SAS

890.806.147-3

Carrera 24 # 47-74

ventas@caldasmedicas.com

Telefono:8859134 – Telefax :8859878

Manizales-Caldas

Manizales, julio 01 de 2020

Señores
ESE HOSPITAL FELIPE SUAREZ
Salamina – Caldas.

ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX basic A
SERIAL #	560042-M20107690015

RECIBIDO	
Nombre	CECILIA GOMEZ GOMEZ
Cedula	101992125
Cargo	ALMACENISTA
Fecha	01/07/2020
Firma	

Hospital Departamental
Felipe Suarez
E.S.E.
Su salud, nuestra razón de ser
ALMACÉN CENTRAL

Atentamente

CECILIA GOMEZ G
Gerente

DESCRIPCIÓN TÉCNICA


NOMBRE COMERCIAL:	KIT DESECHABLE ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización 25 x 33
EMBALAJE:	Caja x 70 unidades.
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011814
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	Óxido De Etileno
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.

Es un producto diseñado para realizar el cambio de vestuario en los pacientes para las diferentes áreas, en procedimientos quirúrgicos, permitiendo protección e higiene en su presentación.

Uso: Protege el paciente de toda contaminación y conserva la dignidad del usuario.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	BATA MANGA JAPONESA T-L MTOA NO ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 30 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa polipropileno de 11x16 C1.2 por 10 unidades
EMBALAJE:	Caja x 300 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	N/A Según decreto 4725 del 2005
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	N/A
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001 en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de saneamiento.

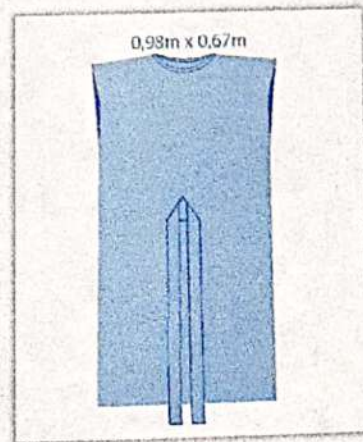



FICHA TECNICA ROPA DESECARTABLE

Código: FT-DT-010-L
 Versión: 01
 Fecha: 02/09/2020

LER PREVENCIÓN

DEPARTAMENTO: DIRECCION TECNICA

FICHA TECNICA BATA QUIRURGICA DESECABLE

1. DATOS GENERALES

NOMBRE GENERICO:	BATA QUIRURGICA DESECABLE SMS 40		
NOMBRE COMERCIAL:	BATA LAMINADA NO ESTERIL	MATERIAL DE FABRICACION:	SMS 40GR
PRODUCTO NACIONAL:	SI	TIPO/GRADO:	DESECABLE
PRODUCTO IMPORTADO:	NO	CODIGO DE BARRAS(EAN 13)	N/A
PRODUCTO ESTERIL:	NO	VIDA UTIL DEL PRODUCTO	5 AÑOS
PRODUCTO GRAVADO IVA	NO	COLOR	AZUL
REGISTRO SANITARIO NO.	NO REQUIERE	VIGENCIA DE REGISTRO SAN	N/A



2. DATOS DE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO:	MANTENGASE EN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y SECO					
CLASIFICACION DEL RIESGO	N/A		EL PRODUCTO ES REUTILIZABLE	NO		
TALLA/MEDIDA:	UNICA		ANCHO MANGA:	32 cms	CALIBRE:	35-40GR
LARGO:	110 CMS		LARGO MANGA	60cms	PRESENTACION	Paq X 10
ANCHO:	140 cms		TIPO DE TELA BASE:	SMS	TELA COMPLEM.	Puño poliester blanco

3. DATOS TECNICOS DEL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO

BATA DESECABLE PARA PACIENTE ADULTO ELABORADA EN TELA SMS ANTIFLUIDO DE 40 GRS CON DOS TIRAS DE AMARRE

BATA QUIRURGICA ESTANDAR CON TIRAS DE AMARRE, PUÑO BLANCO EN ALGODÓN. RESISTENTE A FLUIDOS

TELA NO TEJIDA SMS TELA , HILAZA

4. INDICACIONES Y USOS

BRINDA PROTECCION DURANTE PROCESOS MEDICOS , PROTEJE AL PERSONAL DE LA EXPOSICION A ENFERMEDADES Y MATERIALES PELIGROSOS

NO TRANSPARENTE, LO CUAL BRINDA UN EXCELENTE CONFORT. SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA PUÑO BLANCO

REVISO: LUIS EDUARDO ROJAS
 A CARGO: DAVID DUARTE

APROBO: MYRIAM DUEÑAS


EASY FACE PROTECTOR

Caretas de Protección facial


USOS:



- Medico
- Dental
- Laboratorios
- Industrial
- Alimentos
- Supermercados
- Aseo Doméstico.

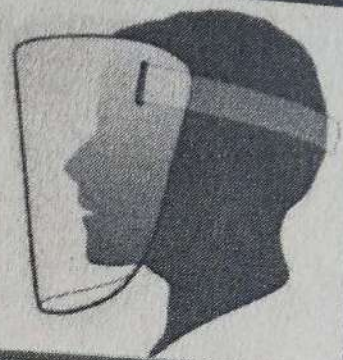

ESPECIFICACIONES

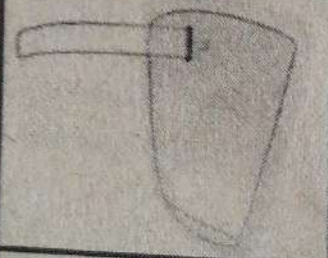

Visor en **PET G** a prueba de salpicaduras, doble cara, antiempañamiento, antiarañados, fuerte resistencia a ácidos y alcalinos.


Estructura adaptable para trabajadores de varios tipos, puede cubrir directamente las gafas de trabajador.

Puede evitar efectivamente infecciones de personal médico causado por fluidos corporales.

Amplia cobertura protectora.

Ligero, diseño ergonómico, cómodo para usar sin sensación de presión.

Doble película protectora en el visor para garantizar asepsia del producto antes del primer uso.

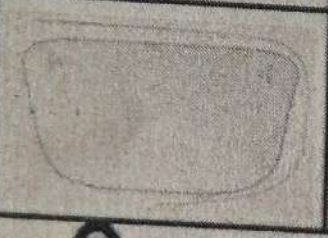

COMPONENTES	MATERIAL	PESO	ESPESOR	DIMENSIONES
Visor	PETG	66 gr	0.75mm	36x23cm
cinta	Polipropileno		Calibre 30	70x3 cm
UNIDAD DE EMPAQUE	TAMANO BOLSA	MASTER PACK	TAMANO MASTER PACK	PESO MASTER PACK
Bolsa x und	A: 28 cm L: 44 cm	Caja de 26 unidades	H: 20 cm L: 43 cm A: 26 cm	1,6 kg aprox.



ADVERTENCIA

- Para mayor durabilidad limpie preferiblemente con paño húmedo con agua o limpiavidrios o lave con agua y jabón de tocador.
- Seque con paño seco suave.
- Nunca limpie con elementos o productos abrasivos ni con ningún solvente o químico.
- Para conservar condiciones de asepsia limpie siempre antes de usar y si es de uso continuo por lo menos cada tres horas.

PROPIEDADES PET G

El **PET G** tiene un aditivo aditivo (**GLICOL**) que hace que el **PET G** sea más transparente, más resistente y más flexible en comparación al **PET**

Buenas propiedades ópticas	Excepcionales prestaciones a bajas temp.	Superficie brillante y cristalina	Muy buena resistencia a agentes químicos
Alta resistencia al impacto	Baja absorción de agua	Fácil reciclaje	Elevada resistencia al fuego BS200

PROPIEDADES POLIPROPILENO

- Aplicaciones:**
- Películas para alimentos, agrícolas, chicles, bolsas tejidas
 - Películas para agricultura (lento de nieblas)
 - Envases industriales (bolsas grandes)
 - Bolsas, cables, cordeleros, fibras para tejidos
 - Bases, alfombras, capas de batería, paraguas y autopartes
 - Cables para agua caliente
- Ventajas y Beneficios:**
- Buena a los rasgos
 - Impermeable
 - Económico
 - Transparente en películas
 - Atóxico
 - Impermeable
 - Blando
 - Resistente a la temp. hasta 135°

PROPIEDAD INTELECTUAL DE DSP FACTORY S.A.S.
Este producto es una propiedad intelectual, y se encuentra en proceso de patente de diseño y registro de marca ante la superintendencia de industria y comercio, su reproducción sin permiso podría acarrear sanciones legales y penales.



**FICHA TÉCNICA
MASCARILLAS ANTIFLUX MB85
GENIO /AVL Maxlife**

Code: FT-31-03 Date: 10/2020 Versión: 03

GENERALIDADES:

PRODUCTO:
SERIE:
REFERENCIA:
DESCRIPCIÓN:



Mascarillas / tapabocas de tres capas uso médico

Telas no tejidas termoselladas

MB - con filtro Meli-Blown

Mascarilla quirúrgica fabricada con 85 g/m² de telas no tejidas a base de polipropileno aptas para el contacto con la piel lo cual ofrece una textura suave. Cuenta con tres capas de telas no tejidas para mayor protección; la capa externa es antfluidos y protege de fluidos externos e internos, la capa de medio actúa como filtro principal y la capa interna ofrece confort. Está diseñada para proteger las vías respiratorias y gran parte del rostro. Cumple la norma técnica NTC 1733 Higiene y Seguridad Equipos de protección respiratoria requisitos generales norma española UNE-EN 14683:2019 + AC para mascarillas quirúrgicas requisitos y métodos de ensayo. La mascarilla es no estéril, libre de patógenos. Autorización del INVIMA para la "Fabricación comercialización de dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos o diagnósticos" Registro 166 - C 2804 - 2020 según resolución 522 de 2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

La mascarilla cuenta con las siguientes especificaciones:

Cumplimiento de norma
Eficiencia de filtración bacteriana
Forma
Largo
Ancho
Ajustador nasal
Número de capas
Tipo de Filtro
Referencia de telas no tejidas
Antfluidos
Densidad de fibra total
Plegues
Elastico
Proceso productivo

NTC 1733 para mascarillas quirúrgicas

= 95% (BFE)

Rectangular

17,5 cm +/- 0,5 cm

9,5 cm +/- 0,5 cm

min 8,0 cm

Tres capas de telas no tejidas con filtro

Meli-blown

Spunbond de Polipropileno

Repelencia al agua -90 norma AATCCM22

min 85 g/m² en tres capas

Tres pliegues faciales

Banda elástica blanca, en cada lado

Sistema automático termosellado con ultrasonido

ORIGEN, EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

Nuestras mascarillas Antiflux MB85 son fabricadas en Colombia bajo las marcas comerciales Genio y AVL Maxlife. Tienen empaque individual, en cajas de 50 unidades. En una caja master se empaquetan 48 cajas, es decir 2400 unidades. Se debe almacenar en lugares higiénicos, frescos y libres de contaminación. Se debe desechar el tapaboca y el empaque de forma adecuada, siguiendo los protocolos de bioseguridad.



**FICHA TÉCNICA
MASCARILLAS ANTIFLUX MB85
GENIO /AVL Maxlife**

Code: FT-31-03 Date: 10/2020 Versión: 03

APLICACIONES

La mascarilla es usada para la protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire y protegen a las personas de fluidos que vayan hacia o desde las vías respiratorias. Es de suave textura y buena respirabilidad cumpliendo la norma técnica Colombiana NTC 1733.

INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

Antes de tocar un tapabocas limpio: Debes lavarte las manos muy bien con agua y jabón. Una vez que hayas aplicado el jabón en tus manos húmedas, frótalas para lavarlas durante al menos 20 segundos antes de enjuagarlas. Siempre usa una toalla limpia para secarte las manos y, luego ponla en un contenedor de basura.


Orienta la parte superior del tapabocas correctamente: Para que el tapabocas quede lo más cerca posible de tu piel, ten en cuenta que la parte superior del mismo tiene un borde flexible, pero rígido, en abombado, que puedes moldear alrededor de tu nariz. Cerciorate que ese lado esté orientado hacia arriba antes de colocarte el tapabocas.

Asegurate que el lado correcto del tapabocas quede hacia afuera. Los fuertes nasales deben quedar hacia arriba en la parte interna, y hacia abajo en la parte externa. Ponse el tapabocas en la cara: Con bandas para las orejas: Algunos tapabocas tienen dos bandas para colocar en cada una de las orejas. Por lo general, estas bandas se hacen de un material elástico para que puedan estirarse. Agarra este tipo de tapabocas por las bandas, ponlas alrededor de tus orejas.

Ajusta la pieza que va en la nariz: Ahora que el tapabocas está en su lugar en la cabeza y la cara, usa el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible de su borde superior, alrededor del puente de la nariz. Ajusta el tapabocas en tu cara y debajo de tu barbilla: Una vez que el tapabocas esté totalmente asegurado, acomódate para que te cubra la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de tu barbilla.

Quitarte el tapabocas con mucho cuidado: Retíralo solamente tocando los bordes, las correas, los lazos, las ataduras o las bandas. No toques la parte frontal debido a que podría estar contaminada. Quitarte el tapabocas de forma segura y procede a lavarlo con agua y jabón o detergente, o procede a desecharlo. En ambientes médicos es probable que haya un cubo de basura específico para elementos de riesgo biológico como tapabocas y guantes usados. En un ambiente no médico donde un tapabocas podría contaminarse de todos modos, debes colocarlo dentro de una bolsa plástica. Amarra la bolsa para cerrarla y luego amójala al cubo de la basura.

Lávate las manos otra vez: Una vez que hayas desechado el tapabocas de forma segura, lávate las manos nuevamente para asegurarte de que están limpias y no se hayan contaminado al tocar el tapabocas sucio.

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018	Página 1 de 3

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Bianco - Negro - Azul - Verde

2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Poliisopreno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza localizando una en la coronilla y otra en la nuca

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018	Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inodoro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de Inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	hermeticidad	NITTA

7. PRESENTACIÓN

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empaquetado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

JUAN PABLO GARCÍA
DIRECTOR DE CALIDAD

GERMAN BLANCO
ASISTENTE DE CALIDAD

IF Rev 04 Fecha Mayo 24 de 2018

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018	Página 1 de 3

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustandola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador. No use el respirador

3.2. Condiciones de Uso

PARAMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19.5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 ⁶ partículas/m ³ TLV-TWA 0,05 mg/m ³
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.


4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	≥ 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H ₂ O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H ₂ O

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolapsamiento, que une las telas evitando que se separen.

>95%
filtración
bacteriana

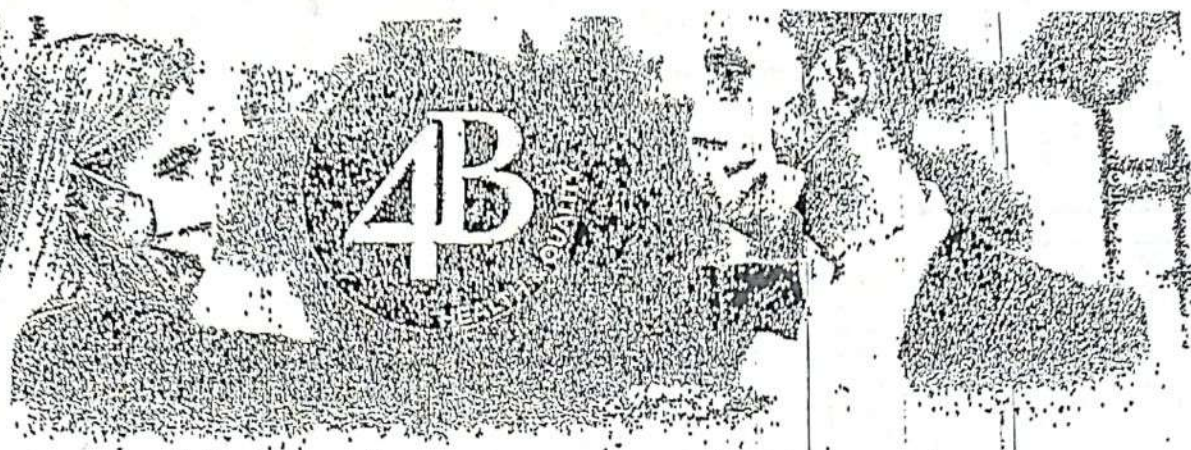

MASCARILLA QUIRÚRGICA

Termosellada de tres pliegues con elástico.

Materiales

Capa Interna:
Tela no tejida Spunbond blanco 25 GSM


Capa Central:
Tela no tejida Meltblown 25 GSM

Capa Externa:
Tela no tejida Spunbond Azul 25 GSM

Elástico libre de latex

Ajuste facial

Dimensiones

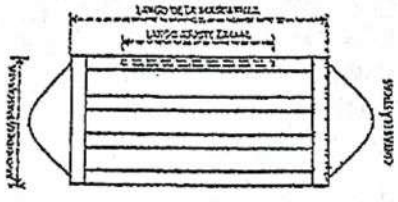

Largo: 17,5 ± 0,3 cm
Ancho: 9,5 ± 0,3 cm

Uso

Barrera de contacto con fluidos corporales, con el fin de prevenir infecciones.

Usar una (1) sola vez.

Desechar en sitios señalizados.

Empaque

Caja Master:
40 Unids. (Cajas individuales)

Caja individual:
50 Unids. (Tapabocas.)

2.000 Tapabocas

Almacenamiento

Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 10° y 34°C; evitar contacto directo con la luz.

5 años de vida útil.

Características

Alta capacidad de filtración bacteriana.

Excelente ventilación y respirabilidad.

Firmeza y seguridad en el sellado de los elásticos.

Tela hipoalergénico.

¿Está listo para protegerse correctamente?
Realice su pedido.



(57) 345 871 89 62

direccion@bfq@gmail.com


Calle 1076-335, Circunvalar,
Bodega M1-1, Metroparque,
Barranquilla, Colombia.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Versión: 00
Fecha emisión: 8/5/2020
Codigo: FTMF-003
Página: 1 de 1

Codigo:	T001
Producto:	Mascarilla quirurgica termosellada de tres pliegues con elástico
Color:	Interior Blanco/ Exterior Azul
Marca:	4B:

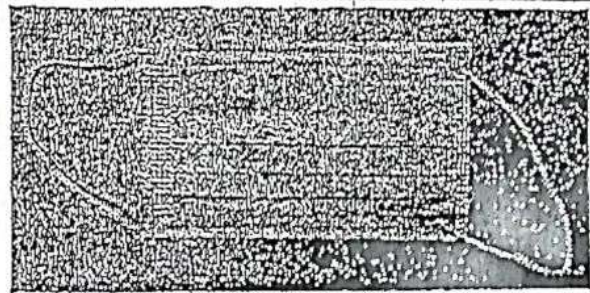

Descripción: Mascarilla Facial termosellada de tres pliegues con elástico para sujeción a la oreja

Material:

Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster
Capa Interna: Tela no tejida Spunbond blanco 25 GSM
Capa Central: Tela no tejida Meltblown 25 GSM
Capa Externa: Tela no tejida Spunbond Azul 25 GSM
Elástico libre de latex
Ajuste facial

Dimensiones:

Dimensiones que cubren perfectamente las entradas a las vías respiratorias
Largo: $17,5 \pm 0,3$ cm
Ancho: $9,5 \pm 0,3$ cm

Eficacia de filtración del material filtrante

BFE $\geq 95\%$.

Uso:

Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire con el fin de evitar infecciones. Se usa en el campo médico, odontológico y quirúrgico.

Apariencia:

Libre de partículas, sin olor.

Condiciones de almacenamiento:

Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 10° a 34°C ; evitar contacto directo con la luz

Inscripción Invima:

38166

Presentación:

Caja x 50 unidades

Nivel de Riesgo:

I

Vida útil:


5 años

Origen:

100% Fabricación nacional

GUANTE DE LATEX ESTERIL WELL

Nombre comercial:	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL	Composición:	N/A
Material:	LÁTEX NATURAL	Presentación:	CAJA X 50 PARES
Dimensiones:	N/A	Peso:	N/A
Marca:	WELL CARE	Referencia:	MD-GU1089; MD-GU1199; MD-GU1199-1; MD-GU1200; MD-PR5805

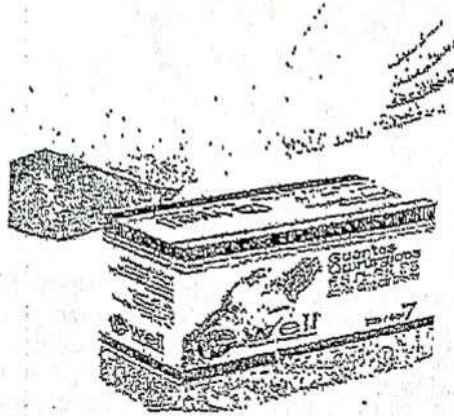

ESPECIFICACIONES

- Registro Sanitario: INVIMA 2014DM-0011686.
- Vencimiento registro sanitario: 2024/07/30
- Clasificación según el INVIMA: Dispositivo médico riesgo IIA.
- Código ATC: No aplica por ser dispositivo médico.


CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en látex natural.
- Bajo potencial alergénico.
- Con borde reforzado.
- Baja concentración de talco.
- Cómoda manipulación, precisa y de gran sensibilidad táctil.
- Esterilizados en rayos gamma.

RECOMENDACIONES

- Para conservar la integridad del guante se recomienda no almacenarlos a altas temperaturas ni en presencia de radiaciones.
- No se aplicarán cremas antes de colocarse los guantes, ya que pueden alterar las propiedades del mismo. Este es

MONOGAFA DE SEGURIDAD VENTILACIÓN INDIRECTA

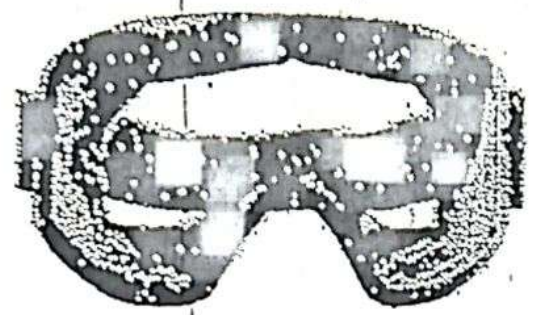

DESCRIPCIÓN

Las monogafas de protección ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo en especial proyección de partículas líquidas y sólidas en gran cantidad. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.

Todas nuestras monogafas están elaboradas en policarbonato de alta calidad y cumpliendo con Normatividad Internacional.

APLICACIONES

La Monogafa de Seguridad aplica para toda las actividades industriales que generen altas concentraciones de material particulado o proyecciones de partículas líquidas.

- Refinación
- Exploración
- Explotación
- Producción
- Transporte
- Alimentos
- Agricultura
- Logística
- Almacenamiento
- Mantenimiento
- Ambiental
- Puertos marítimos
- Farmacéutica
- Forestal
- Fuerzas Militares
- Aeronáuticas
- Ensambladoras
- Pesqueras
- Minería
- Construcción
- Supervisión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monogafa de cuerpo en PVC I de alta flexibilidad.

Monolente de policarbonato de 2,0mm de grosor

- Monolente con tratamiento anti-empañante (AF).
- Marco con briflos de ventilación indirecta en la parte superior.
- Resistencia a salpicaduras, impactos de alta velocidad e ignición
- Ensamble sin partes metálicas (no conductor)
- Banda elástica negra para ajuste de 13mm
- Ofrece buen sello y ajuste al rostro
- Diseño ergonómico
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6
- Peso 75,5g
- Certificado ANSI Z87.1-2015

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas. Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.
- Esta monogafa es adecuada para proteger contra salpicaduras e impacto
- Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda otros tipo de monogafa.
-
- **LIMPIEZA:**
- Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

REFERENCIA

Lente Claro

USOS

Monogafa Clara permite la trasmisión de luz máxima en actividades internas o espacios cerrados.

EMPAQUE

Unitario

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
01-02-21	CUBIA	Jux Gutermeño	Esteban Valencia	Tapebo	Gorra	7:00 AM	
			Luis Perera				
			Rebeca Quintan				
			Monica Naranjo				
02-02-21			Janeli Castañeda				
			Monica Naranjo				
			Rebeca Quintan				
			Elisavinda Osorio				
03-02-21			Diana Rappone				
			Carolina Osorio				
	Esteban Valencia						
	Diana Rappone						
	Janeli Castañeda						
04-02-21			Esteban Valencia			7:00 AM	
			Luis Muñoz				
			Monica Naranjo				
05-02-21			Carolina Osorio			7:00 AM	
			Marcos Ramirez				
			Monica Naranjo				
			Luis Muñoz				
			Janeli Castañeda				
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES		91					



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.

GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE



VERSIÓN 2

Código: GD-HFS.P

PAG. 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
01-02-21	URG	M. Interna	Laura Ballesteros	N95-Tap	Buena	7+00	
01-02-21	URG	M. SOS	Angela Moreno	N95-Tap	Buena	8+00	
01-02-21	URG	Conductor	Roben D. Rivera	Tapabocas	Buena	8+00	
01-02-21	URG	Conductor	Juan P. Ramirez	Tapabocas	Buena	8+00	
01-02-21	URG	Portero	Omair Hamin	Tapabocas	Buena	"	
01-02-21	URG	Ext. Sena	Nekim Maya	Tapabocas	Buena	"	
02-02-21	URG	Enfermera	Mamaria Uaya	N95-Tap	Buena	7+00	
02-02-21	URG	Portero	Fabio Cano	Tapabocas	Buena	"	
04-02-21	URG	M. General	Francisco Guerra	N95-Tap	Buena	"	
04-02-21	URG	M. General	Juan J. Lopez	N95-Tap	Buena	"	
04-02-21	URG	M. Interno	Juan P. Garcia	N95-Tap	Buena	"	
04-02-21	URG	AUX. ENF	Claudia Amas	N95	Buena	"	
04-02-21	URG	AUX. ENF	Paula Gallego	N95	Buena	"	
04-02-21	URG	Portero	Humberto Hamin	Tapab- N95	Buena	"	
05-02-21	URG	AUX. ENF	Lizabel Mejia P.	N95-Tap	Buena	14+00	
05-02-21	URG	AUX. ENF.	Yuliana Arzob	N95-Tap	Buena	14+00	
05-02-21	URG	Portero	German Castañeda	N95-Tap	Buena	14+00	
05-02-21	URG	AUX. ENF	Estefania Cano	N95	Buena	"	
05-02-21	URG	AUX. ENF	Johanna Laxario	N95	Buena	"	
05-02-21	URG	AUX. ENF	Carolina Cardona	N95	Buena	"	
05-02-21	URG	AUX. ENF	Carolina Orjano	N95	Buena	"	
05-02-21	URG	AUX. ENF.	Ariedy Mejia	N95	Buena	"	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES		22					

Dirección: Calle 3ª No. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: www.esfelipesuarez.gov.co

E-mail: correspondencia@esfelipesuarez.gov.co



Hospital Departamental Felipe Suarez ESE

GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE



VERSIÓN: 2
Código: GD-HESP
PÁGINA DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
23-01-21	UCI	AUX ENFERMO					
29/01/21	UCI	Enfermera	Claudia A.	KIT		04:00	
01/02/21	UCI	Aux Enfermera	Isolina	KIT		04:30	
01/02/21	UCI	ENFERMERA	Daniela Orcampo	N95		19:30	
22/02/21	UCI	Aux enfermera	Felipe	KIT		8:00	
22/02/21	UCI	Aux enferme.	Anstina	Bata G.		14:00	
22/02/21	UCI	Medico	Silvia	N95		23:00	
23/02/21	UCI	Medico	Juan Jose	N95		23:00	
23/02/21	UCI	Enfermera	Cecilia	N95		23:00	
23/02/21	UCI	Doctera	Silvia				
23/02/21	UCI	Aux	Karen				
23/02/21	UCI	E. enfermera	Cecilia				
23/02/21	UCI	Enfermera	Natalia Montoya				
23/02/21	UCI	Enfermera	Juan Pte Montemayora	N-95		02:00	
23/02/21	UCI	Enfermera	Alvaro Tena G.	N-95		21:40	
24/02/21	UCI	Enfermera	Maria Montoya	N-95		20:00	
24/02/21	UCI	Enfermera	Claudia Acevedo			04:00	
24/02/21	UCI	Aux enfer	Fátima			8 pm	
24/02/21	UCI	Aux enfer	Fátima			8 pm	
NIVEL DE RIESGO				DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO	
TOTAL TRABAJADORES				8			

Dirección: Calle 3ª No. 9-A-21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196. Telefax 8595306

Página Web: www.esfefelipesuarez.gov.co
E-mail: correspondencia@esfefelipesuarez.gov.co



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2020/10/16

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
MEDICAMENTOS				
05 SEVORANE X 250 ML	UNI	5	385,000.00	1,925,000.00
				1,925,000.00
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO				
0102894 ADAPTADOR DE OXIGENO	UNI	1	46,400.00	46,400.00
0102324 AGUA OXIGENADA GALÓN	UNI	2	45,000.00	90,000.00
0102005 AGUJA HIPODERMICA	UNI	1,700	96.85	164,655.20
0102752 AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 25	UNI	150	8,925.00	1,338,750.00
0102011 ALCOHOL ANTISEPTICO X 750	UNI	69	4,500.00	310,500.00
0102012 ALCOHOL GLICERINADO GEL ANTIBACTERIAL	UNI	20	24,000.00	480,000.00
0102003 ALGODON TIPO HOSPITALARIO	BOL	11	10,800.00	118,800.00
0102550 ALGODONERA	UNI	6	29,750.00	178,500.00
0102013 APLICADORES X 100	PAQ	8	4,291.27	34,330.22
0102014 BAJALENGUAS X 100	CAJ	8	5,212.50	41,700.00
0112083 BATA PACIENTE EN GENERO	UNI	150	2,500.00	375,000.00
0102366 BATA QUIRURGICA DESECHABLE MANGA LARGA	UNI	240	6,500.00	1,560,000.00
0102576 BISTURY CUCHILLA N. 20 - 15	UNI	600	386.75	232,050.00
0102753 BOLSA PARA RESERVORIO DE AMBU	UNI	3	17,255.00	51,765.00
0102453 BONZYME - DETERGENTE MULTIENZIMATICO	UNI	6	38,000.00	228,000.00
0102488 BRAZALETE TENSIOMETRO DE 2 VIAS ADULTO	UNI	4	20,825.00	83,300.00
0102896 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE	UNI	3	35,300.00	105,900.00
0102283 CANULA NASAL OXIGENO ADULTO	UNI	50	1,750.00	87,500.00
0102021 CANULAS DE GUEDELL ADULTA Y PEDIATRICA	UNI	6	1,600.00	9,600.00
0102027 CAT CUT CROMADO 0,1,2/0,3/0,4/0	UNI	30	8,500.00	255,000.00
0102028 CAT GUT SIMPLE 2/0	UNI	12	8,500.00	102,000.00
0102037 CIDEX	UNI	2	225,000.00	450,000.00
0102657 CIDEX OPA 4 GALON	UNI	12	29,000.00	348,000.00
0102654 CLIP UMBILICAL DESECHABLE	UNI	50	892.50	44,625.00
0102041 DRENES DE PENROSE	UNI	6	17,255.00	103,530.00
0102374 ELECTRODO REHUSABLE PARA TEES PAQUETE X 4	UNI	5	25,000.00	125,000.00
0102302 ELECTRODOS DESECHABLES PAQ. X 50 3M	UNU	2	17,500.00	35,000.00
0102754 ELECTRODOS PARA DEA	UNI	1	225,000.00	225,000.00
0102038 ENMASCARAR CINTA PARA ESTERILIZAR	UNI	3	15,870.83	47,612.50
0102044 EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL	UNI	1	61,880.00	61,880.00
0102608 EQUIPO JACKSON	UNI	5	65,000.00	325,000.00
0102046 ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO	ROL	3	49,499.30	148,497.91
0103148 ESPECULO PARA OTOSCOPIO	UNI	1	11,305.00	11,305.00
0102277 ESTERILIZAR BOLSA 135 X 280	UNI	1	105,000.00	105,000.00
0102279 ESTERILIZAR BOLSA MEDIANA	UNI	3	45,000.00	135,000.00
0102280 ESTERILIZAR BOLSA PEQUEÑA CAJA X 200	UNI	2	26,500.00	53,000.00
0102047 FIJADOR PARA CITOLOGIA	UNI	2	14,875.00	29,750.00



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2020/10/16

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	
01021005	FORMOL X 500 ML	UNI	4	10,621.00	42,484.00
01021016	FORMULA 55X - (QUATERZAN)	UNI	2	75,833.33	151,666.66
0102405	GAFAS SEGURIDAD AJUSTABLES	UNI	4	9,500.00	38,000.00
0102048	GASA TIPO HOSPITALARIO	ROL	10	54,000.00	540,000.00
01020690	GEL PARA ELECTRO GALON	UNI	1	27,500.00	27,500.00
0102049	GLICERINA	UNI	2	10,115.00	20,230.00
0102050	GORROS DESECHABLES	UNI	500	450.00	225,000.00
0102051	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN	UNI	131	32,592.85	4,269,663.87
0102052	GUANTES ESTERILES	PAR	1,200	1,150.00	1,380,000.00
0102607	HEMOSTATICO ABSORBIBLE 3.5	UNI	2	19,500.00	39,000.00
0102921	HEMOSTATICO ABSORVIBLE CELULOSO 10X5.1CM	UNI	3	19,500.00	58,500.00
0102789	HEMOVACK 1/4, 1/8	UNI	6	43,845.83	263,075.00
0102397	INCENTIVO RESPIRATORIO HUDSON I BOLA	UNI	5	25,000.00	125,000.00
0102437	INDICADOR QUIMICO STERIS	UNI	1	101,150.00	101,150.00
0102330	INHALOCAMARA ADULTO NACIONAL	UNI	10	10,500.00	105,000.00
0102054	ISODINE ESPUMA	GLN	1	59,500.00	59,500.00
0102055	ISODINE SOLUCION	GLN	1	59,500.00	59,500.00
0102476	JABON QUIRURGICO GALÓN	UNI	4	29,500.00	118,000.00
0102234	KIT DE TENSIOMETRO Y FONENDO WANSUN	UNI	6	63,708.33	382,250.00
0102146	LAPIZ PARA ELECTRO	UNI	30	11,305.00	339,150.00
0102427	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLES	UNI	50	2,500.00	125,000.00
0102059	MALLA DE POLIPROPILENO (30 X 30)	UNI	1	365,000.00	365,000.00
0102162	MANGUERA CON FILTRO PARA EVACUADOR DE	UNI	1	255,850.00	255,850.00
0102867	MANTA TERMICA	UNI	24	12,500.00	300,000.00
0102260	MASCARA LARINGEA N. 4	UNI	1	65,000.00	65,000.00
0102069	MICROPORE 1"	ROL	16	3,400.00	54,400.00
0102070	MICROPORE 2"	ROL	15	6,800.00	102,000.00
0102071	MICROPORE X 3"	ROL	9	10,200.00	91,800.00
0102072	NIPLE	UNI	4	2,975.00	11,900.00
0102586	NITROFURAZONA 500GR	UNI	7	75,000.00	525,000.00
0102592	PAPEL CRAPADO MEDIO ROLLO 100 METROS	UNI	1	96,002.77	96,002.77
0102074	PAPEL MONITOR FETAL	UNI	2	16,645.00	33,290.00
0102075	PAPEL PARA DESFIBRILADOR	RLO	4	14,875.00	59,500.00
0102177	PAPEL PARA ELECTRO 63X30	UNI	2	8,925.00	17,850.00
0102469	PAPEL PARA ELECTRO 80 MM	UNI	5	6,902.00	34,510.00
0102076	PAPEL PARA ELECTRO Z	UNI	8	10,115.00	80,920.00
0102346	PERAS CON VALVULA PARA TENSIOMETRO	UNI	3	14,875.00	44,625.00
0102080	PLACAS ELECTROBISTURI	UNI	15	11,305.00	169,575.00
0102081	POLAINAS DESECHABLES	UNI	200	950.00	190,000.00
0102756	POLIPROPYLENE 0, 1, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0	UNI	207	9,500.00	1,966,500.00
0102139	PREPODYNE SCRUB BOLSA X 850 CC	UNI	8	27,000.00	216,000.00


HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2020/10/16

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	
0102418	SABANAS RESORTADAS DESECHABLES	UNI	20	2,853.65	57,073.08
0102478	SEDA 2/0 REF. 654	UNI	58	8,500.00	493,000.00
0102479	SEDA 3/0 75CM 16MM	UNI	22	3,000.00	66,000.00
0102090	SEDA SUTURA 0	UNI	5	8,500.00	42,500.00
0102893	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO	UNI	2	155,000.00	310,000.00
0103263	TAPABOCAS N-95 X UNIDAD	UNI	98	5,618.77	550,639.56
0102281	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL LORD	UNI	5	12,500.00	62,500.00
0102339	THERABAN GRIS	UNI	2	10,400.00	20,800.00
0102579	TIJERA MAYO 14.5 CMS HOSPITAL RECTA	UNI	2	12,028.00	24,056.00
0102111	TIRILLAS GLUCOCARD TEST STRIPP	UNI	13	60,000.00	780,000.00
0102901	TORNIQUETE AUTOADHESIVO VELCRO	UNI	3	4,248.30	12,744.90
0102123	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5	UNI	10	2,800.00	28,000.00
0102124	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0	UNI	30	2,800.00	84,000.00
0102125	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5	UNI	30	2,800.00	84,000.00
0102126	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0	UNI	5	2,800.00	14,000.00
0102088	VICRIL 1,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0	UNI	84	9,800.00	823,200.00
					24,743,856.67
REACTIVO LABORATORIO					
0103182	AGAR CROMOGENICO MARCA BBL CAJA X 20	UNI	10	5,200.00	52,000.00
0103006	AGAR MUELLER HINTON X 1	UNI	20	4,500.00	90,000.00
0102458	AGUA DESIONIZADA TAMBOR X 20 LITROS	UNI	2	60,000.00	120,000.00
0103007	AGUJA MULTIPLE 21 X 1 1/2	UNI	27	32,074.69	866,016.87
0103227	AMBELISS POTENSIADOR LISS X 10ML	UNI	1	32,000.00	32,000.00
0103126	AMILASA 405 AA LIQUIDA 3 X 10ML	UNI	1	185,000.00	185,000.00
01030103	ANTI B MONOCLONAL X 10 ML MOVATEC	UNI	2	16,000.00	32,000.00
0103104	ANTI D MONOCLONAL X 10 ML	UNI	1	22,000.00	22,000.00
0103121	CALIBRADOR PLUS 2X 3 ML	UNI	1	425,000.00	425,000.00
0103513	CELULAS I Y II X 5 ML	UNI	1	58,000.00	58,000.00
0103183	CIPROFLAXINA SENSIDISCO FCO X 50	UNI	3	23,000.00	69,000.00
0103025	COLESTEROL HDL DIRECTO CON CALIBRADOR X 80	FCO	1	510,000.00	510,000.00
0103455	CONTROL PARA ORINA 3X8 ML 14 PARAMETROS	UNI	1	115,000.00	115,000.00
0103027	CREATININA 4 X 50ML	UNI	1	120,000.00	120,000.00
0103300	CURITA ADHESIVA CJA X 100	UNI	5	5,600.00	28,000.00
0103032	DESHIDROGENASA LACTICA LHD LIQUIDA X 100 ML	UNI	1	130,000.00	130,000.00
0103029	DILUYENTE X 20 LITROS	UNI	2	275,000.00	550,000.00
0103213	DIMERO D CAJA X 25 DET	UNI	1	375,000.00	375,000.00
0103040	GAMMA GT X 100ML	UNI	1	185,000.00	185,000.00
0103203	HCG PRUEBA RAPIDA CASSETE X 40	UNI	1	40,000.00	40,000.00
0103111	HEPATITIS B X 30 DET	UNI	1	110,000.00	110,000.00
0103700	HIV X 30 PRUEBA RAPIDA STANDARD	UNI	2	125,000.00	250,000.00
0103044	LAMINA CUBRE OBJETOS	CAJ	5	5,355.00	26,775.00


EL SUSCRITO JEFE DE ALMACEN

CERTIFICA

A la fecha contamos en stock los siguientes elementos de protección personal:

ELEMENTO	CANTIDAD
Tapabocas caja x 50 und	500
Tapabocas N95 x unidad	3900
Guantes des caja x 100	105
Polainas des x par	500
Alcohol antiséptico x 700ml	36
Gorro tipo oruga x 100	600
Bata paciente x unidad	70
Bata desechable manga larga x unidad	5300
Monogafas	7

Para constancia se firma a los cinco (05) días del mes febrero de 2021

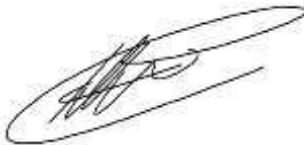

CRISTIAN CAMILO RIOS RIOS
Jefe Central Suministros



Hospital Departamental Felipe Suárez

E.S.E.

Salamina - Caldas

NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

FRS INTERASIA

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Alcohol		1	1		
Geetas clo		1	1		
Microscopio 211		1	1		
Electrodo de ens		5	5		

Firma Jefe de Servicio:

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental Felipe Suárez

E.S.E.

Salamina - Caldas

NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

UCI

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Electrodos		1	1		
Tijeras		4	4		
Máquina ganchos		2	2		
Gancho coxalera		2	2		
Ploma corta		1	1		
2 laves de 10 lts		10	10		
Tupaluces		5	5		
Tupaluces x 15		100	100		
Alcohol glicerinado		10	10		
Desinfectantes		5	5		
Parrillas		3	3		
Sucopinchos		3	3		
Sucopandas		2	2		
Alcohol		10	10		
tbls. lila y amarillo		100	100		
Pato hombre		6	6		
Pato mujer		6	6		
Punzones		4	4		
Marcador sensible		5	5		

Firma Jefe de Servicio:

Samuel...

1756304357.

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental Felipe Suárez

E.S.E.

Salamina - Caldas

NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

UCI

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Glucómetro		3	3		
Amilla		3	3		
Niplos		10	10		
Guentos des		10	10		
Gorro desechable		200	200		
Careta		5	5		
Queral		70	70		
Batas esteriles		50	50		
Bata desechable		20	20		
Marcaador sharpie		5	5		
Lapicero y lapiz		5% 5%	5%		
Esperadorcjo		1	1		
Microscopio 2"		5	5		
Manillas identificación		1000	1000		
Pulido cordo		1	1		
Control. Inyectados		3	3		
Guante medica		1	1		
Plan cuadrado aneurisma		500	500		
Pelanos		100	100		

Firma Jefe de Servicio:

Daniela Ocampo Osorio

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental Felipe Suárez

E.S.E.

Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:


HOSPITALIZACIÓN

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Polvos		100	100		
Escleros desecables		1	1		
Oxido		1	1		
Gemas		4	4		
topobacos		1	1		
Alcohol		2	2		
Microscopio 1, 2, 3		10	10		
Gemas des		4	4		
Alcohol		2	2		
topobacos		1	1		
Botas precintas		10	10		
Cidex		2	2		
Guedes 201		2	2		
Ubu amasillo		1	1		
Primo corta		1	1		

Firma Jefe de Servicio:

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.
Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio: HOSPITALIZACIÓN Fecha: _____

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Tinillas glucometro		1	1		
Agujas 18	Caja	1	1		
Tapeadores	Caja	1	1		
Bata paciente		1	1		
Bata mangas larga		1	1		
Gauchos des		5	5		
Alcohol glicerinado		2	2		
Micropare 1"		2	2		
Alcohol		5	5		
Overol antipluie		5	5		
Pastos		20	20		
Gomas		100	100		
Palanos		100	100		
debe amable		1	1		
Gauchos des		3	3		
Alcohol		3	3		
Alcohol glicerinado		1	1		
Aplicadores		1	1		
Bata paciente		10	10		

Firma Jefe de Servicio:

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E.

Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

Hospitalización

Fecha:

DETALLE

Present.

Cant.
Pedida

Cant.
Desp.

Valor
Unit.

Valor Total

Papel monitor

2 2

~~Guantes~~

~~cap 3 3~~

Guantian

2 2 2

~~Tapabocas~~

~~cap 1 1~~

Resma corta

4 1 1

Sharpie

1 1

Resaltador

1 1

filas

1 1

tubo lila

1 1

Microport 1"

2 2

Microport 2"

1 1

Resma corta

1 1

Resma opio

1 1

~~Geores~~

~~1 1~~

~~Geores dos~~

~~4 4~~

~~Alcalal glicerinado~~

~~1 1~~

Bala percente

10 10

Guardian 2.9

1 1

Marcador borrable

1 1

Firma Jefe de Servicio:

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental Felipe Suárez

E.S.E.

Salamina - Caldas

NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

HOSPITALIZACIÓN

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Pelanas		100	100		
Eschardos desechables		1	1		
Oxímetro		1	1		
Guantes		2	2		
topolucas		1	1		
Alcohol		2	2		
Microspice 1, 2, 3		10	10		
Gauntos des		2	2		
Alcohol		2	2		
topolucas		1	1		
Bata percente		10	10		
Cidex		2	2		
Gerden 20		2	2		
Ibu amasillo		1	1		
Prumo corta		1	1		

Firma Jefe de Servicio:

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.

Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

PYP

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Guantes dos		3	3		
Procelador BK		60	60		
tuñer 17A		1	1		
Resma Carta		1	1		
Resma OFCO		1	1		
Guardaones		3	3		
Bojalengas		1	1		
Aplicador		1	1		
Tirilla		1	1		
Bata ML		10	10		
Sabana		5	5		
Guantes		3	3		
Tapabocas		1	1		
Alcohol		1	1		
Carpetas		2	2		
Alcohol glicerinado		1	1		
tirillos		1	1		
Manoplas		2	2		
Sharpie		1	1		
Firma jefe de servicio	Vo.Bo. Asistente Administrativo				



Hospital Departamental Felipe Suárez

E.S.E.

Salamina - Caldas

NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

URGENCIAS

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Alcohol		2	2		
Gambos des		5	5		
Sabones		10	10		
Moche ante		3	3		
Moche opio		1	1		
Micropor 3"		1	1		
Tijillas		1	1		
Alcohol		3	3		
papel EKG		1	1		
Rotulos verdes		1	1		
Basalenguas		1	1		
Aplicadores		1	1		
Polainas		1	1		
Gorros		1	1		
TUBOS Azules		1	1		
Alcohol Glicerinado		1	1		
Micropor 1"		2	2		
Guanter		3	3		
Guanter esteniles 6 1/2		1	1		

Firma Jefe de Servicio:

Xiomara Maya Agudelo
Enfermera Profesional
C C 1 059 812 603

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.

Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:


urgencias

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Tapabocas		100	100		
Alcohol		21	21		
Guanter des		5	5		
Plasma carta		1	1		
Vaseline		2	2		
Polainas		1	1		
Gomas		1	1		
Tubo cila		1	1		
Tubo rojo		1	1		
Alcohol		4	4		
Guanter		6	6		
papel EKG		2	2		
Plasma Carta		2	2		
Plasma Oficio		1	1		
Marcador Borrable		1	1		
Rosetario		2	2		
Pegostic		1	1		
Lapicero		1	1		
Aguja Vacotainer		1	1		

Firma Jefe de Servicio:
Xiomara Maya Agudero
Enfermera Profesional
C C 1 059 812 603

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental Felipe Suárez

E.S.E.

Salamina - Caldas

NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

URGENCIAS

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
cidex		3	3		
Gel Antibacterial		2	2		
Micropore 2"		4	4		
Micropore 3"		2	2		
Sabanas		20	20		
Tarapoboceros φX		50	50		
Gunks des		5	5		
Boyd electro z		1	1		
Tubo Cila		1	1		
Tubo Rojo		1	1		
Furacin		1	1		
Pepartic		1	1		
Jabon φX Galon		1	1		
Papel EK6		1	1		
Electrodos		1	1		
Micropore. 2"		2	2		
Pesma carta		2	2		
FRASCOS OMINOL		50	50		
Alcohol		4	4		

Firma Jefe de Servicio:

Vo.Bo. Asistente Administrativo:

Xiomara Maya Agudelo
Enfermera Profesional
C.C. 1.059.812.603

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

MANIZALES



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.

Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

Urgencias.

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Cip Pequeño		2	2		
Baja lenguas		1	1		
Tapos		1	1		
Gel ultraromido		1	1		
Taco esparadrapo		1	1		
Vickil		10	10		
Prolene 20		5	5		
lloves 3 uias		4	4		
Tijillas		2	2		
Guantes		2	2		
globo protectores		1	1		
Guantes		5	5		
Alcohol		3	3		
Tapobarcas N95		100	100		
" Quirúrpico		50	50		
caucho para aspirador		4mt	4mt		
Papel EKG		3	3		
Electrodos		1	1		
Guantes		5	5		

Firma Jefe de Servicio:

Xiomara Maya Agudelo
Enfermera Profesional
C C 1 059 812 603

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E.

Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8


PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

urgencias

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Alcohol Glicerinado		4	4		
Termómetro		1	1		
Pluma Cartera		2	2		
Pluma Oficina		1	1		
Alcohol		8	8		
Guantes		1	1		
Jabón		20	20		
Genito castaña		1	1		
Sharp 10		1	1		
Presillador		1	1		
Alcohol		1	1		
Genitos des		1	1		
torniqueto colorado		1	1		
Microscopio 211		2	2		
libro amarillo y lila		100	100		
Microscopio 1 y 2		100	100		
Alcohol		2	2		
Genitos des		2	2		
Algodón		1	1		

Firma Jefe de Servicio: 

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental Felipe Suárez

E.S.E.
Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

URGENCIAS

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
tipobancos		2	2		
Curas		1	1		
Algodonosa		1	1		
Sobanos		5	5		
Guardias. 2.0		1	1		
Ayuda curativos		2	2		
Portiquete		1	1		
Sharpio		1	1		
Gauchos clas		2	2		
Plomacast		1	1		
Cidex		1	1		
Papel FKG		2	2		
Micropore 2"		1	1		
Tijillas		1	1		
Lancetas		1	1		
Gauchos		5	5		
Pegante		1	1		
Guardianes					
Gauchos Esteriles 6 1/2		1	1		

Firma Jefe de Servicio:

Xiomara Maya Agudelo
Enfermera Profesional
C C 1 059 812 603

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E.

Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

urgencias.

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
clip pequeño		1	1		
resaltador		1	1		
Marcador bonable		1	1		
informe Anestesia		50	50		
resma carta		2	2		
resma OFICIO		1	1		
Junco 87x		1	1		
Alcohol		3	3		
micropore 3" y 2"		1c/u	1c/u		
Guantes		3	3		
Tubo Ula		1	1		
Tubo Amovillo		1	1		
Tapabocas		1	1		
Plomo-cable		2	2		
Micropore 2"		1	1		
liga sticker verb		1	1		

Firma Jefe de Servicio:

Xiomara Maya Agudelo
Enfermera Profesional
C C 1 059 812 603

Vo.Bo. Asistente Administrativo:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

SALAMINA - CALDAS

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio: LABORATORIO

Fecha: _____

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unitario	Valor Unitario
Alcohol		1	1		
Alcohol		1	1		
fba amarilla		2	2		
fba lila		2	2		
Jabón quirúrgico		1	1		
Aguja vacutainer		2	2		
Proctoctor ama		50	50		
tupobacos N95		20	20		
Gauchos des		2	2		

Firma, _____
 JEFE DE SERVICIO

Vo Bo _____
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

SALAMINA - CALDAS

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio: LABORATORIO Fecha: _____

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unitario	Valor Unitario
tdoo amarillo		2	2		
telocuzol		1	1		
Aguja vacutainer		2	2		
Alcohol		1	1		
Procedotor ocina		50	50		
Guanles des		2	2		
Cbro actor		1	1		
Guanles des		2	2		
teparucos		1	1		
Alcohol		1	1		
Batos		10	10		
Blancos		100	100		
tdoo amarillo		2	2		
Vacutainer		2	2		
Ceros		5	5		
Procedotor Oana		100	100		
Shorpie		1	1		
Alcohol glicernado		1	1		
Guanles des		2	2		

Firma, Yenny Amaya
JEFE DE SERVICIO

Vo Bo _____
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E.

Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

Quirófano

Fecha:

DÉTALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Sistema drenaje torácico Horwack III		1	1		
Sobana		10	10		
Micropore 2"		2	2		
Micropore 3"		1	1		
Gasa		2	2		
Bata		20	20		
Papel desinfectador		1	1		
Prose corta		2	2		
Placa electrobiología		10	10		
Aguja espinoza		150	150		
Tubos quirúrgicos		1	1		
Pelanas	Paq.	2	2		
tapabocas		1	1		
Gauntos deos		5	5		
Gauntos esteriles		200	200		
tercin		1	1		
Benzymr		1	1		

Firma Jefe de Servicio:

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.

Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

QUIRÓFANO

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Microport 1 y 3		100	100		
Alcohol	botella	3	3		
Zona	rollo	3	3		
Algodón	rollo	3	3		
Bata manga larga		20	20		
Suantes (limpio)	caja	3	3		
Suantes estériles		3	150		
6 1/2 - 7 0 - 7 1/2 - 8		3	150		
Capabocas	caja	1	1		
Electrobisturi		5	5		
Electrodos	Pte	1	1		
Guardian		3	1		
Resma corte		1	1		
Frío Parcial Ohrs		1	1		
Placa electrobisturi		5	5		
Preparare		1	1		
Españadrapo		1	1		
Miapore 1		3	3		
Secb. 310		12	12		

Firma Jefe de Servicio:

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.
Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

GRUPO

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Orono parraso		3	3		
Dembillo bipin		1	1		
Manguera N30		1	1		
Gautes cas		8	8		
Micropore 2"		2	2		
Micropore 3"		2	2		
Vicryl 0		36	36		
Vicryl 1		36	36		
Vicryl 30		24	24		
Pantofila gut amonida 200		13	13		
Alcohol	botella	3	3		
Gautes caja					
Gautes estériles		100	100		
Gasa	rollo	2	2		
Papel oregado	rollo				
Algodón 75	rollo	2	2		
Bata manga corta	Sabanas	1	1		
Manguera		12	12		
Torniquete		1	1		
Firma Jefe de Servicio:					
Vo.Bo. Asistente Administrativo:					

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ - SALAMINA



Hospital Departamental Felipe Suárez

E.S.E.

Salamina - Caldas

NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

QUIRÓFANO

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Masas cortas		1	1		
Isodine esama		1	1		
Isodine solución		1	1		
Benzylme		2	2		
Polomas		100	100		
Corros		100	100		
Pero-aspirar		1	1		
Aguja espirocen 25		39	39		
Equipo anestesia epidural		1	1		
Bibbery cachillos		400	400		
Batas		20	20		
Llave tres vias		20	20		
Conta para esterilizar		1	1		
Aguja oxigenada		1	1		
Gantos des		2	2		
topabacos		1	1		
Malla polipropileno		1	1		
Sosa		2	2		
Camposas		5	5		

Firma Jefe de Servicio:

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.

Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:


QUIRURANO

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Gauntos des		2	2		
Placas electro		5	5		
Pedono 310		42	42		
Gauntos des		3	3		
Casa		2	2		
Suturas		10	10		
Pinza ceca		1	1		
Control liquidos		4	4		
Informe de anestesia		500	500		
Placas perose		3	3		
Pedono 110		22	22		
Shorpio, hopiz, resaltador		196	196		
fijeros		1	1		
Clip stando		1	1		
Clip mripaxi		1	1		
Payento en barra		1	1		
Bolsa oxigenizar grande, mediana, pequena, extra pequena		106	106		
Soro fonzador		1	1		
Alcohol		2	2		

Firma Jefe de Servicio:

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.
Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:


QUIROFANO

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Asomi cecia		1	1		
Gantes dor		3	3		
Indicador biologico		5	5		
antropocorona		1	1		
Amolador		1	1		
Gasa		2	2		
Vicryl 2/0		36	36		
Prolene 3/0		24	24		
Banzyme		1	1		
Control medicamentos		5	5		
Esporcetrupe		1	1		
Espanya hemostatica		3	3		
Micropore 1"		2	2		
Micropore 2"		2	2		
Micropore 3"		1	1		
Liga clips		18	18		
ALCOHOL		3	3		
Prepodyne bolsa		2	2		
Ceras		1	1		

Firma Jefe de Servicio:

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E.

Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:


Quirófano

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Sistema drenaje torácico thoracostich III		1	1		
Sabana		10	10		
Microspire 2"		2	2		
Microspire 3"		1	1		
Gasa		2	2		
Bata		20	20		
Papel desinfectador		1	1		
Prosema corta		2	2		
Placa electroanalisis		10	10		
Agua espumosa		150	150		
Talco quirúrgico		1	1		
Pelamas	Pag.	2	2		
tapabocas		1	1		
Gentes des		5	5		
Gentes esteriles		200	200		
Percein		1	1		
Banzymr		1	1		

Firma Jefe de Servicio:

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental Felipe Suárez

E.S.E.

Salamina - Caldas

NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

Consumo Cateteriza

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Alcohol glicerinado		1	1		
Mosma carta		2	2		
Mosma Carta		2	2		
Alcohol		2	2		
Papel ecayrop electo 2		2	2		
Rayostic		1	1		
Gambos aros		3	3		
Gambos aros		3	3		
Alcohol		2	2		
Bebe		10	10		
Parmela SSR		1	1		
Mosma carta		3	3		
Papel electo 2		2	2		
Exámenes auxiliares		500	500		
Micropene 1 y 2		100	100		
Gel electro		1	1		
Imbr 648		1	1		
Mosma carta		3	3		
Alcohol glicerinado		1	1		

Firma Jefe de Servicio:

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.

Salamina - Caldas
NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:


CONSULTA EXTERNA

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Gauntos des		3	3		
Alcohol		3	3		
Prosmolecta		2	2		
Papel electro 2		2	2		
Caja clips		1	1		
Cencho coxadora		1	1		
Llave tres usos		10	10		
Microscopio 2"		1	1		
Prosmo-carla		2	2		
Cidox		1	1		
Alcohol		2	2		
Prosmolecta		1	1		
Gauntos des		3	3		
Alcohol		3	3		
Gauntos des		3	3		
Microscopio 1"		2	2		
Papel electro 2		2	2		
Baja brujas		2	2		
Aplicadores		2	2		

Firma Jefe de Servicio:

Vo.Bo. Asistente Administrativo:



Hospital Departamental
Felipe Suárez

E.S.E.

Salamina - Caldas

NIT. 890.801.026-8

PEDIDO A ALMACÉN

Servicio:

CONSULTA EXTERNA

Fecha:

DETALLE	Present.	Cant. Pedida	Cant. Desp.	Valor Unit.	Valor Total
Esparaceltrapa		1	1		
Glicomado		1	1		
lentes		1	1		
Coordin 2.9		3	3		
Requerer en botas		1	1		
Bata		10	10		
Pharmocerta		3	3		

Firma Jefe de Servicio:

Vo.Bo. Asistente Administrativo: