






	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ E.S.E	Versión : 001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Emisión 13-06-2019
Formato Actas		

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Fecha:	18/02/2021	Hora: 2:00 pm
Lugar:	Hospital Departamental Felipe Suárez	
Dependencia que Convoca:	Área de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Proceso:	Reunión semanal del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST	
Objetivo:	Presentar informe semanal de las acciones realizadas por el Hospital Felipe Suárez y Sintrasersalud para la prevención y contención del COVID-19	
Agenda:		
1. aprobación del acta anterior 2. Revisión de tareas pendientes 3. Tareas		
Desarrollo:		
Se cuenta con la participación de los representantes del COPASST, la coordinadora del SGSST de la institución.		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión del acta anterior: Se hace lectura el acta anterior la cual es aprobada y se revisa con el fin de verificar la pertinencia de las acciones y evidencias enviadas para la prevención y contención del COVID- 19. 2. Se revisa el cumplimiento de las tareas pendientes: <ul style="list-style-type: none"> - Se socializa el Plan de Trabajo anual expuesto por la coordinadora del SG-SST, es aprobado por el COPASST. - Por parte de la coordinadora de SGSST del Hospital y en asesoría con la ARL Positiva, se continúa trabajando en la actualización del Manual de Bioseguridad teniendo en cuenta los cambios efectuados en el Hospital. - Se realiza inspección de Comportamiento seguro y uso de Elementos de Protección Personal en el área de urgencias por parte de los integrantes del COPASST. - Se reciben formatos de EPP entregados en los diferentes servicios 3. Varios: <ul style="list-style-type: none"> - En espera de la respuesta de la ARL Colmena, para que realice acompañamiento al COPASST - Se reciben EPP por parte de la ARL Positiva. 		
Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
1. Envía informe al ministerio	Coordinadora SGSST	Inmediato
2. Realizar inducción y re inducción en el Sistema de	Coordinadora SGSST	Sujeto a la aprobación del plan de trabajo

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ E.S.E	Versión : 001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Emisión
	Formato Actas	13-06-2019

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			
3. Realizar invitación a la ARL Colmena	Coordinadora SST-Sintrasersalud	Inmediato	
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
María Cecilia Álvarez Álzate	Servicios Generales	Hospital Departamental Felipe Suárez	
Lina Paola Valencia Gonzalez	Coordinadora SGSST	Hospital Departamental Felipe Suárez	
María del Carmen Arias	Servicios Generales	Hospital Departamental Felipe Suárez	
Gerardo Andrés Cajas Muñoz	Medico	Hospital Departamental Felipe Suárez	
Próxima reunión	Fecha	Hora	
	25/02/2020	2:00 pm	



LISTADO DE PERSONAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ

AREA	NOMBRE	CARGO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
MANTENIMIENTO	LASSO MUÑOZ JORGE WILMER	MANTENIMIENTO / BIOMEDICO	INTERMEDIO
	ESCUADERO RIOS FRANCISCO ALONSO	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	
	RESTREPO OSPINA WILSON ANDRES	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	
	QUINTERO GIRALDO ALEXANDER	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	
	HERNANDEZ GONZALEZ LUIS GERMAN	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	
	GARCIA CAMPUZANO JOSE LUIS	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	
	RAMIREZ LUIS ALFONSO	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	
ACOMPANIAMIENTO A USUARIO	MARIN PEÑA JOSE OMAR	portero/ ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO	DIRECTO
	CANO CASTAÑO FABIO NELSON	portero/ ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO	
	CASTAÑEDA CASTAÑEDA GERMAN	portero/ ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO	
	DIAZ VALENCIA HENRY	portero/ ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO	
	MARIN MARULANDA JOSE HERIBERTO	portero/ ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO	
SERVICIOS GENERALES	ARIAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS GENERALES	DIRECTO
	CARDONA ARROYAVE MARIA ORFANERY	SERVICIOS GENERALES	
	DELGADO VALENCIA BLANCA LUCIA	SERVICIOS GENERALES	
	FLOREZ AGUDELO MARY LUZ	SERVICIOS GENERALES / MEDIO TIEMPO SAN FELIX	
	HIDALGO RAMIREZ LUZ BELLA	SERVICIOS GENERALES	
	OCAMPO RENDÓN LUZ AMPARO	SERVICIOS GENERALES	
	OSORIO LOAIZA AMPARO	SERVICIOS GENERALES	
	QUINTERO GALVIS BIBIANA	SERVICIOS GENERALES	
	AMAYA ARCILA GLORIA NANCY	SERVICIOS GENERALES	
	SANCHEZ ARROYAVE LUISA FERNANDA	SERVICIOS GENERALES	
	ALVAREZ ALZATE MARIA CECILIA	SERVICIOS GENERALES	
TRANSPORTE PACIENTES	VANEGAS RIVERA FERNANDO	TRANSPORTE DE PACIENTES	DIRECTO
		TRANSPORTE DE PACIENTES / MEDIO TIEMPO SAN FELIX	
	RAVE DIAZ JORGE OBDUBER	TRANSPORTE DE PACIENTES	
	CARDONA AGUIRRE MAURICIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	
	RAMIREZ MARIN JUAN PABLO	TRANSPORTE DE PACIENTES	

TR/
DE I

ADMINISTRATIVOS

OSPINA CASTAÑO NESTOR FABIO	TRANSPORTE DE PACIENTES
RIVERA LEIVA RUBEN DARIO	TRANSPORTE DE PACIENTES
AGUDELO OSORIO VALENTINA	AUDITORIA DE CALIDAD
VALENCIA GONZALEZ LINA PAOLA	COORDINADORA SG-SST
DIAZ RESTREPO LUIS GERMAN	COORDINADOR DE CARTERA Y COSTOS
RIOS DUQUE LUIS EDUARDO	COORDINADOR SIAU
RIOS RIOS CRISTIAN CAMILO	COORDINACION / ALMACEN Y MANTENIMIENTO
LONDOÑO RIOS ELIANA MARCELA	COMUNICACIÓN SOCIAL
ZULUAGA VILLEGAS RAFAEL ANTONIO	APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y AL TALENTO HUMANO
CASTAÑO GERMAN DARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / GESTION DOCUMENTAL
GONZALES QUISICUE ROSARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / RECURSO HUMANO
HIGUERA GALVEZ DIANA YANETH	SECRETARIA
PATIÑO RINCÓN VALENTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS
VALENCIA MARIN MONICA MARÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS
LADINO TREJOS OMAR ANDRES	COORDINACION FACTURACIÓN
OSORIO ARREDONDO LUIS NORBEY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FACTURACION CENTRAL
CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION
GOMEZ LOPEZ MARIA CLEMENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / APOYO A COORDINACION DE FACTURACION CENTRAL
GARCÍA AGUIRRE SANDRA MILENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION
HENAO CARDONA DIANA MARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION
MORALES AMAYA MARTHA LILIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION
MARTINEZ BETANCUR ALBA NERY	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION
HERNANDEZ OSORIO CONSUELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / ASIGNACION DE CITAS
CARDONA ECHEVERRY JOHAN SANTIAGO	PLANEACION
LOPEZ VASQUEZ ALEJANDRO	PLANEACION
MORALES AMAYA MARIA ALEJANDRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / COSTOS Y CARTERA
CARMONA DUQUE WILSON DIDIER	GERENTE

INTERMEDIO

ENFERMERIA

GOMEZ ZULUAGA MARIA ALEYDA	ASESORA
RINCON SOTO LIANA PATRICIA	SECRETARIA
HURTADO BLANDÓN LILIANA PATRICIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ZULUAGA MARIA YOLANDA	AUXILIAR DE INFORMACION EN SALUD
GIRADO GOMEZ BLANCA AURORA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ PAGADURIA
CARMONA CIFUENTES ANA OLIVIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SAN FELIX
GOMEZ MONTOYA ALVARO OCTAVIO	REVISOR FISCAL
RAMIREZ OCAMPO DIANA CLEMENCIA	SANEAMIENTO FISCAL
RUIZ JHOVANY	APOYO CONTROL INTERNO
MORALES JARAMILLO SANDRA BIBIANA	CONTADORA
MEDINA MAYA GONZALO	ASESOR JURIDICO
CUBILLOS SOTO FELIPE HERNANDO	ASESOR JURIDICO
AGUDELO GALLEGO YULI ANA	AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA
AGUDELO GARCÍA FRANCIA ELENA	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA
ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
ALZATE RAMÍREZ JENNY PAOLA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN
AMAYA AMAYA YENNNY ALEXANDRA	AUX ENFERMERIA / AUX LABORATORIO
ARIAS VALENCIA CLAUDIA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS
BOTERO CARDONA MERY (paso de urg a cons a paritr del	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS
CARDONA GOMEZ PAULA MARIANA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN
CARDONA GONZALES DIANA CAROLINA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS
CASTAÑEDA DUQUE ALBA JANNETH	AUX ENFERMERIA / P Y P
CASTAÑO QUICENO MARIA NORA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS
CORRALES HERNÁNDEZ MARIANA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN
FLOREZ AGUDELO DANIELA	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX
GALLEGO PATIÑO PAULA ANDREA (paso de 3° a urg a par	AUX ENFERMERIA / P Y P - AMBULANCIA
GARCIA GIL LUCY YANED	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA
GARCÍA GIL SORANGIE	AUX ENFERMERIA / P Y P
GAVIRIA HERNANDEZ ISLENY	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN
GÓMEZ MEJÍA LUCY EDILEN	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN
HERRERA OSORIO MANUELA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN
LASCARRO MEJÍA HEIDY JOHANNA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS
MARIN CARDONA YESICA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN

AUX DE ENFERE	MUÑOZ HERNANDEZ LINA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	DIRECTO
	MURILLO REYES DEIBY SANTIAGO	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	
	NARANJO ALZATE MONICA CONSTANZA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	
	OSORIO GÓMEZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	
	OSORIO PEREZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	
	OSORIO PEREZ MARTHA CECILIA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	
	PATIÑO MEJÍA MARIA ISABEL	AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA	
	QUINTERO CEBALLOS DIANA PAOLA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	
	QUINTERO DIAZ DANIELA	AUX ENFERMERIA / P Y P	
	RAMIREZ MORENO ANGELA VIVIANA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	
	VALENCIA OROZCO ESTELA	AUX ENFERMERIA / P Y P	
	OROZCO LUZ ADRIANA (paso a partir del 16 a 3°)	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	
	CASTRILLON VASQUEZ PAOLA ANDREA	AUX ENFERMERIA / P Y P	
	VALENCIA MARULANDA ESTEBAN	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	
	VELEZ SIERRA JHESIKA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / P Y P	
	VICTORIA MOSQUERA TATIANA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	
	CANO MONTES ESTEFANÍA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	
	GRANADA CAÑÓN MANUELA	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	
	MEJIA GOMEZ ARLEDY	AUX ENFERMERIA / P Y P	
	ALZATE GIRALDO ALBA LUCIA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	
	HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA ELSY	AUX ENFERMERIA / AISLAMIENTO	
	ALCANTARA RAMOS KAREN SHIRLEY	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	
	JHOANA JIMENA GONZALES	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	
ALVAREZ ORDONOÑEZ ISABEL CRISTINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI		
LONDOÑO RESTREPO EDISON	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI		
RAYOS X	PACHECO BRACHE MIGUEL DE JESÚS	TECNOLOGO EN RAYOS X	DIRECTO
	RUIZ ZAPATA DIANA MILENA	TECNOLOGA EN RAYOS X	
FARMACIA	RIOS GALLEGOS DIANA LUCIA	AUX DE FARMACIA	INTERMEDIO
	LONDOÑO GONZALEZ ALEJANDRA	QUIMICA FARMACEUTICA	
	LONDOÑO GONZALEZ ALEJANDRA	QUIMICA FARMACEUTICA	
	ARANGO RAMIREZ CLAUDIA YOLIMA	AUX DE FARMACIA	
ENERAL	AGUDELO SALAZAR NESTOR RAUL	MEDICO GENERAL / COORDINADOR	DIRECTO
	ARIAS PATIÑO ANA RUBIELA	MEDICO GENERAL COLPOSCOPISTA	
	CORDEQUE LOZANO MARIA FRANCISCA	MEDICO GENERAL / UCI	

MEDICOS G	GUERRA ORTIZ FRANCISCO JOSE	MEDICO GENERAL	DIRECTO
	LOPEZ TAMAYO JUAN JOSE	MEDICO GENERAL	
	RAIGOSA ARANGO MARIA CRISTINA	MEDICO GENERAL	
	RIOS CARVAJALINO ISABELLA	MEDICO GENERAL	
	CAJAS MUÑOZ GERARDO ANDRES	MEDICO GENERAL	
ENFERMERAS	MAYA AGUDELO XIOMARA	ENFERMERA / URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA	DIRECTO
	RIOS ORTIZ YULIMAR	ENFERMERA / P Y P - SAN FELIX	
	OCAMPO OSORIO DANIELA	ENFERMERA / UCI	
	AGUDELO FERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA	ENFERMERA / UCI	
	GOMEZ MONTOYA NATALIA	ENFERMERA / UCI	
	VELÁSQUEZ CASTRILLÓN MARISOL	ENFERMERA / COORDINACION - CIRUGIA Y HOSPITALIZACION	
ODONTOLOGIA	HOLGUIN GOMEZ ISABELLA	ODONTOLOGA /	DIRECTO
	MARULANDA GARCIA STEFANIA	AUX DE ODONTOLOGIA	
	ACEVEDO LONDOÑO JUAN CAMILO	ODONTOLOGO / COORDINACION	
LABORATORIO	GIRALDO NARANJO SARA JEIN	BACTERIOLOGA / LABORATORIO	DIRECTO
	ARIAS MURILLO JULIANNA CAROLINA	BACTERIOLOGA / COORDINACIÓN	
ESPECIALISTAS	GONZALEZ MEDINA PAULA ANDREA	PSICOLOGA	DIRECTO
	AGUIRRE SANCHEZ LEIDY	FISIOTERAPEUTA	
	VELEZ DUQUE LEIDY JOHANA	FISIOTERAPEUTA / UCI	
	GARZON HERRERA EDNA LUCIA	FISIOTERAPEUTA / UCI	
	MARIN SIPAGAUTA JUAN SEBASTIAN	FISIOTERAPEUTA / UCI	
	BEDOYA GOMEZ VALERIA	FISIOTERAPEUTA / UCI	
	PEREZ IGLESIAS LUIS AUGUSTO	INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	
	AGUDELO FERNADEZ JUAN CARLOS	ORTOPEDISTA	
	STEER MARTINEZ JUAN FELIPE	ORTOPEDISTA	
	GURROLA CHACON RAUL ARMANDO	ORTOPEDISTA	
	ROSALES LORA JOHN CARLOS	CIRUJANO GENERAL	
	MENDOZA GOMEZ MIKE LEON	CIRUJANO GENERAL	
	MARTINEZ VALLEJO WILLIAN JOSE	CIRUJANO GENERAL	
	SALDOVAL PEREZ RAUL ANTONIO	ANESTESIOLOGO	
	LOPEZ SANCHEZ AMILCAR	ANESTESIOLOGO	
	GONZALEZ GOMEZ DANIELA	GINECO OBSTETRA	
DAVILA ARIAS LILIANA DEL SOCORRO	GINECO OBSTETRA		

MEDICOS RURAL	CHICA GUTIERREZ JOSE EDGAR	MEDICINA FAMILIAR	
	SERNA GRANADA CARLOS ANDRES	MEDICO INTERNISTA	
	MEJIA GUTIERREZ DARIO	MEDICO INTERNISTA	
	RODRIGUEZ BERMUDEZ JAIME ANDRES	MEDICO INTERNISTA	
	GALLEGO VILLARRIAGA INGRID CAROLINA	OTORRINOLARINGOLOGA	
	BOTELLO JAIMES JHON JAIRO	INTENSIVISTA	
	BELTRAN NOVOA JUAN JOSE	MEDICO RURAL	DIRECTO
	CORDOBA ARANGO LAURA	MEDICO RURAL	
	TRIVIÑO CASTRO SILVIA PAOLA	MEDICO RURAL	
	MONTEMIRANDA MONTENEGRO JUAN JOSE	MEDICO RURAL	
	GUEVARA BOTERO KATTERINE	MEDICO RURAL	
	MORENO OSPINA ANGELA MARIA	MEDICO RURAL	
	CARDONA OSPINA VALERIA	MEDICO RURAL	

IDENTIFICACION F
Constante. Equipamento
LUDOS

Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

INSTRUCCIONES DE USO

GUANTE DE LATEX QUIRÚRGICO CON Y SIN POLVO

Ámbito de uso: Los guantes quirúrgicos con polvo se utilizan para la barrera biológica contra la contaminación de las manos de los usuarios que pretenden obtener contacto con el paciente y para evitar la contaminación entre el paciente y el examinador para un solo uso.

Instrucciones: Precaución: - Este producto está hecho de látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas.

Almacenamiento: - Evitar la luz solar directa, mantener en un lugar fresco y seco.

Vida útil: 5 años en la fecha de fabricación.

DECLARACION DE EMPAQUE

GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES CON POLVO Y SIN POLVO

Caja dispensadora / Caja interior:

Material utilizado para la caja dispensadora	: Cartón de revés gris de 450g
Dimensión de caja dispensadora	: 220mm x 130mm x 225mm
Tipo de impresión	: Impresión a 1 color y barniz

Caja de cartón:

Material utilizado para la caja de cartón	: 275 / 275 / una estría
Dimensión de la caja dispensadora	: 540mm x 450mm x 235mm
Tipo de impresión	: Impresión a 1 color

Bolsa:

Material utilizado para la bolsa	: Medicoat GL 60/3g y Papel PE 40/18g
Dimensión para la bolsa	: 130 mm x 203 mm
Tipo de Impresión	: Impresión 1-2 colores

- a) 1 par de guantes(1 izquierda y 1 derecha) por envoltura interior
- b) 1 envoltura interior por bolsa
- c) 50 bolsas por dispensador
- d) 8 dispensadores por caja

TG MEDICAL SDN. BHD

Este producto tiene una validez de 5 años desde la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento está impresa en las cajas.

GUANTES NEWMEK

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Los guantes quirúrgicos de látex en polvo (palma textura)

SECCIÓN I: Descripción del producto

1. Tipo 1 guante de látex quirúrgico, en polvo, estéril
1. 2 Material Natural High Grade látex de caucho
1. 3 Color Natural
1. Diseño y 4 de funciones específicas de la mano, los dedos curvados, palma textura, puño con reborde
1. 5 Polvo dentro de almidón de maíz absorbible USP 1
1. 6 Condiciones de Almacenamiento Los guantes mantendrán sus propiedades si se guardan en un estado seco. Evite la luz solar directa.
1. 7 Estabilidad Los guantes deben tener vida útil de 5 años desde la fecha de fabricación.
1. 8 estilo de embalaje 1 par (1 izquierda y 1 derecha) de guantes por envoltura interior. 1 envoltorio interno por cada bolsa. 50 bolsas por liberador. 8 dispensadores por caja.
1. Marcado 9 Tamaño El tamaño de los guantes se marcará en la casilla de verificación en cada caja con tinta negro.

Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

SECCIÓN II: Requisitos de funcionamiento

(Plan de Muestreo - ISO 2859 individual normal)

AQL: 1.5

#	CARACTERISTICAS	NIVEL DE INSPECCION	NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE	NORMA TECNICA APLICATIVA
2.1	Dimensiones	S2	4.0	ASTM D3577-09e1
2.2	Propiedades físicas	S2	4.0	ASTM D3577-09e1
2.3	Ausencia de poros (TEST DE AGUA ESTANCAADA)	GI	1.0	ASTM D3577-09e1
2.4	Los defectos visuales: (I) Mayor Visual (II) Menor Visual Basic	GI	2.5 4.0	PRACTICA IN HOUSE
2.5	Embalaje defectuoso: (i) Regulado (ii) Visual (iii) Críticos (incl. Guantes conteo)	GI GI S2	** 4.0 4.0	PRACTICA IN HOUSE
2.6	Cantidad de polvo	N=2	N/A	ASTM D3577-09 ^{e1} ASTM D6124-06 (2011)
2.7	Esterilización	^	N/A	^US Pharmacopeia

** Inaceptable en cualquier nivel


SECCIÓN III: ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

3.1 DIMENSIONES

DESCRIPCION	TAMAÑO	ESTANDAR
Longitud (mm)	Todos los tamaños	Min 280
Ancho de palma (mm)	5.5	72 +/- 4
	6.0	77 +/- 5
	6.5	83 +/- 5
	7.0	89 +/- 5
	7.5	95 +/- 5

TG MEDICAL SDN. BHD

	8.0	102 +/- 6
	8.5	108 +/- 6
	9.0	114 +/- 6
Espesor (mm) * Pared simple	Todos los tamaños	Dedo: 0,15 +/- 0,02 (Valor típico: 0,16 - 0,17) Palma: 0,13 +/- 0,02 (Valor típico 0,13 - 0,14) Puño: 0,12 +/- 0,02 (Valor típico: 0,11 - 0,12)

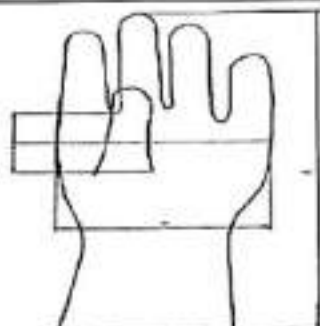

3.2 Propiedades Físicas

Descripción	Estándar	
	Antes de uso	Después de uso
Elongación y descanso (%)	Min. 750 (Tipo de valor: 750 - 900)	Min. 560 (Tipo de valor: 560 - 800)
Resistencia a la tracción (MPa)	Min. 24 (Tipo de valor: 24 - 30)	Min. 18 (Tipo de valor: 18 - 25)

3.3 Ausencia de poros

El tamaño de la muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras se determinarán de acuerdo al plan de muestreo ISO 2859-1 individual normal mediante la

Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

inspección y el nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño.


3.4 Los defectos visuales

El tamaño de la muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras, tanto para defectos mayores y menores serán determinados de acuerdo a la norma ISO 2859-1 del plan de muestreo individual normal el uso de Inspección y nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño.

3.5 Defectos de envasado

El tamaño de la muestra y el número permisible de productos no conformes en las muestras de los defectos de envasado de regulación, visuales y críticos se determinarán de acuerdo al plan de muestreo ISO 2859-1 individual normal el uso de Inspección y nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño (guantes Contando = 50 pares por el dispensador).





República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015035333 DE 7 de Septiembre de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMÁTICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARÁ EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO: GUANTES QUIRÚRGICOS ESTERILIZADOS (GUANTES CON POLVO Y SIN POLVO) - GUANTES DE LATEX QUIRÚRGICOS ESTERILES (CON POLVO Y SIN POLVO)

MARCA: NEWMEK

REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2015DM-0013582

TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER

TITULAR(ES): PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA

FABRICANTE(S): TG MEDICAL SDN BHD CON DOMICILIO EN MALASIA

IMPORTADOR(ES): PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA

ACONDICIONADOR(ES): PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA

TIPO DE DISPOSITIVO: NO INVASIVO

RIESGO: IIA

COMPOSICIÓN: LATEX DE CAUCHO NATURAL, ZDBC, ZDEC, ÓXIDO DE ZINC, FENOL, IMPEDIDO POLIMÉRICO, AZUFRE, DIOXIDO DE TITANIO.

USOS: UTILIZADOS COMO BARRERA BIOLÓGICA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE LAS MANOS DEL USUARIO, ESTÁN PREVISTOS PARA EL CONTACTO CON EL PACIENTE Y PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN ENTRE EL PACIENTE Y EL EXAMINADOR, PARA UN SOLO USO, GARANTIZAN CONDICIONES SANITARIAS DE HOSPITAL MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL PACIENTE A LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA. TAMBIÉN SIRVEN PARA PROTEGER A LOS PROFESIONALES, TRABAJADORES DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES A TRAVÉS DEL CONTACTO CON FLUIDOS CORPORALES.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: CAJA DISPENSADORA, CON 50 BOLSAS X DISPENSADOR, BOLSA DE PAPEL INDIVIDUAL, SELLADA, EMPACADA, CON 1 PAR DE GUANTES (1 IZQUIERDA Y 1 DERECHA), 8 DISPENSADORES POR CAJA.

VIDA ÚTIL: 5 AÑOS


EXPEDIENTE NO.: 20098138

RADICACIÓN NO.: 2015115887

FECHA DE RADICACIÓN: 04 09 2015

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.





República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015035333 DE 7 de Septiembre de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyecto: Legal: kpuemas, Técnico: jperrea.Revisá: Cordina_varios

Firma válida

Digitally signed by ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Date: 2015.09.07 08:05:33 -05'
Reason: I am the author
Location: Bogotá, CO

Página 2 de 2



GP 22 - 1



SC 7341 - 1




CD-SC 7341-1

Referencia
CARETA ANTIFLUX 25

Descripción de la pieza
Caretas cuya pantalla es fabricada en PET CAL25.

Aplicación
Caretas de protección antiruidos y anti objetos extraños, con potencialidad de ser utilizada en sectores industriales y de la salud.

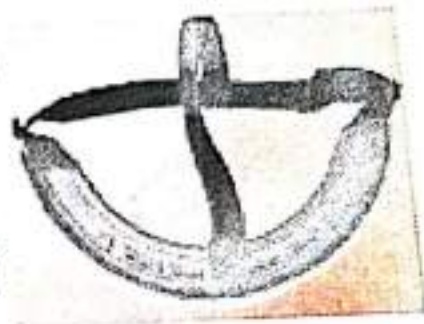

Recomendaciones antes del Uso
Se sugiere realizar pruebas según sea la aplicación a la que será sometida el producto. El uso del producto determinará la vida útil del mismo.

Condiciones de almacenamiento
La careta de protección no debe ser expuesta a fuentes de calor cercanas ni rayos solares de manera directa, adicional debe estar protegido de la humedad y evitar contaminación con material particulado como polvo. Para su almacenamiento debe estar cubierto con bolsas y dentro de la caja, tal como se entrega de fábrica.



Especificaciones de unidad de empaque
Bolsa plástica en PEBD, caja individual de cartón (12 caretas por caja) y caja master de cartón (9-6 cajas individuales).

General

El comportamiento real del producto, dado a su aplicabilidad, podrá ser evidenciado en las instalaciones del cliente.



DESCRIPCION:

- Guantes de exploración desechables, elaborados a base de látex natural, sin polvo y/o ligeramente polvosados con polvo biodegradable.
- Guantes ambidiestros, máxima comodidad y flexibilidad.
- No estériles.
- Multienpaque, con dispensador que garantiza la integridad del producto.
- Exento de materia extraña, rebabas y oristas cortantes.
- Aislado, hipotérmico, atóxico.

CARACTERISTICAS

- Elaborados de 100% Látex natural, sin polvo y/o ligeramente lubricados con polvo biodegradable calidad USP.
- Resistentes a la elongación.
- Color natural.
- De forma anatómica, zona de agarre texturada y con superficie lisa, tersa y uniforme antideslizante.
- Cumple con las pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las Normas Internacionales Vigentes: ISO 11193, EN 455-2, EN 455-3 y ASTM D 2578-01.

INDICACIONES

- Para realizar exámenes, procedimientos médicos y limpieza de pacientes.
- Demás procedimientos clínico hospitalarios.
- En caso de manipulación de material contaminado y para realización de pruebas de laboratorio.

VENTAJAS

- Fácil uso
- Hipotérmico
- Ajuste exacto y suave
- Fuerte y durable
- Libre de olores desagradables.

DIMENSIONES


Propiedad	Talla	Estándar	Color	Textura
Longitud (mm)	XS	Mínimo 220 mm	Natural (Todas las tallas: XS, S, M, L, XL)	Tersa, lisa, antideslizante (Todas las Tallas: XS, S, M, L, XL)
	S			
	M	Mínimo 230		
	L	Mínimo 240		
XL				
Ancho de Palma (mm)	XS	72 ± 10		
	S	89 ± 10		
	M	95 ± 10		
	L	111 ± 10		
	XL	118 ± 10		
Espesor (mm)	Todas las tallas	Dedo: 0.05		
		Palma: 0.08 Bocamanga: 0.06		

FICHA TECNICA PRECISION CARE



Protección de manos en tratamientos médicos no estériles.
Fabricados con los estándares de la norma ASTM D3578.

- Fabricados en látex natural.
- Alta resistencia a la tracción y abrasión.
- Anatómicos manga larga.
- Revestimiento de almidón que reduce la fricción sobre la piel y permite un ajuste perfecto y confortable.
- Color natural.
- Borde enrollado.

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Blanco - Negro - Azul - Verde

2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Polipropileno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza, localizando una en la coronilla y otra en la nuca



CALDAS MEDICAS SAS

890.806.147-3

Carrera 24 # 47-74

ventas@caldasmedicas.com - servicioalcliente@caldasmedicas.com

Telefono:8859134 - Telefax :8859878

Manizales-Caldas

Manizales, Julio 10 de 2.020

Señores
HOSPITAL FELIPE SUAREZ
Salamina - Caldas

REF:

ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX Basic A
SERIAL #	560042-M20107690015


RECIBIDO	
Nombre:	
Cedula:	
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

Atentamente,

CECILIA GOMEZ GOMEZ.

Gerente

EQUIPOS MEDICOS - LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS
MATERIALES QUIRÚRGICOS - ODONTOLÓGICOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustándola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, No use el respirador

3.2. Condiciones de Uso

PARÁMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 ⁶ partículas /ft ³ TLV-TWA 0,05 mg/m ³
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	> 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H ₂ O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H ₂ O

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolapsamiento, que une las telas evitando que se separen.

**FICHA TÉCNICA**

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4

FLI-18

VERSIÓN
N° 04FECHA DE VIGENCIA
2018

Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inoloro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	Hermeticidad	Nitta

7. PRESENTACIÓN

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

**GERMAN SUAREZ S.
DIRECTOR DE CALIDAD**

N° Revisión: 04 Fecha: 03 Noviembre de 2018


Guantes de Examen Desechables



ISO 9002



CE



FICHA TECNICA


- Guantes AQL 1.5
- Elaborados en látex natural.
- Ambidextros, cómodos y de fácil postura.
- No estériles
- Pre-entalcados con almidón.
- Con orillo
- Empaque: Dispensador : 100 unidades por peso- Caja: 10 dispensadores
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades Físicas según ASTM D3578: (00)-(01)

ESTANDARES DE CALIDAD

- Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002.
- Cumple y/o excede los estándares ASTM 3578-95
- Cumple y/o excede los estándares europeos EN 455-1/2/3.
- Cumple y/o excede Norma Técnica Colombiana NTC 4277.
- Auditado por SGS.
- Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP. • Plan de Muestreo ISO 2851

PROPIEDADES FISICAS	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO		ESTANDARES ASTM D 3578 (D1)		Nivel de Inspección
	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	
Fuerza Tenil	Min 21MPa	Min 16MPa	Min 14MPa	Min 14MPa	1.5
Elongación	Min 700%	Min 500%	Min 650%	Min 500%	2.5

Caja x 100un	CÓDIGOS DE BARRAS		UNIDAD	Caja x 24un	CÓDIGOS DE BARRAS		UNIDAD
	GUANTES EXAMTEX TALLA XS	770 727036 3548	770 727036 7450			GUANTES EXAMTEX TALLA XS	770 727036 7450
GUANTES EXAMTEX TALLA S	770 727036 3650	770 727036 7460		GUANTES EXAMTEX TALLA S	770 727036 7460		
GUANTES EXAMTEX TALLA M	770 727036 3660	770 727036 7470		GUANTES EXAMTEX TALLA M	770 727036 7470		
GUANTES EXAMTEX TALLA L	770 727036 3677	770 727036 7484		GUANTES EXAMTEX TALLA L	770 727036 7484		



www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750

Parrue Industrial San José - Ronda 10 v 11 - Manz C. Km 4 Via Finza Siberia - Cundinamarca - Colombia

GUANTES DE VINILO DESECHABLES

VINYL DISPOSABLE GLOVES



ESTANDARES DE CALIDAD

- Cumple los Estándares ASTM D5250-00
- Cumple los Estándares Europeos EN 455-00

INFORMACION TECNICA

- Ambidextros, cómodos y fáciles de poner y quitar.
- Sin talco
- Terminación con orillo.
- No estériles.
- Fabricado de Vinilo (Cloruro de Polivinilo), Grado: FPC DNV2P.
- Doble capa de PVC/ PU que provee una mayor seguridad.
- Forma de Empaque: Dispensador 100 unidades por peso en Caja
 - de 10 dispensadores.
 - Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades físicas y dimensiones según ASTM D5250-99, ASTM D5250-00

BENEFICIOS

- Súper flexibles y livianos.
- Libre de olor, resultado de una formulación especial.
- Buen agarre en superficies pegajosas.
- Otorga una solución alternativa a las personas que son alérgicas al látex.
- Usos habituales: Limpieza, manipulación de alimentos, hobbies, procedimientos odontológicos, inspección de mercancías y control de calidad.

ASPECTOS	NUESTRO PRODUCTO	ASTM D5250 (99)
FUERZA TENSIL	Min. 9 Mpa	Min. 9 MPa
ELONGACION	300%	300%

DIMENSIONES	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO					ASTM D5250 (00)				
	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL
LARGO	230mm					230mm				
ANCHO		86+5	95+5	109+5	115+5		76+5	88+5	102+5	114+5
CALIBRE (mm)	DEDOS		PALMA		PUÑO	DEDOS		PALMA		PUÑO
	0.16+0.03		0.15+0.03		0.12+0.03	0.05 mín.		0.08 mín.		-



www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750
 Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 - Manz.C Km.4 Vía Funza Siberia. Cundinamarca, Colombia


Producto descartable, diseñado con los mejores estándares de calidad, con una alta capacidad de resistencia al paso de microorganismos y tecnología antifluído. Brinda confort con características higiénicas y antialérgicas.

Uso: Procedimientos quirúrgicos realizados por el personal médico y paramédico del medio hospitalario. (producto médico de clase I)



ACTA DE ENTREGA

Nº ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1 1122	Batón americano con refuerzo en manga y pecho	1
2 976	Toalla para secado de manos	1
3 2546	Indicador de esterilización	1

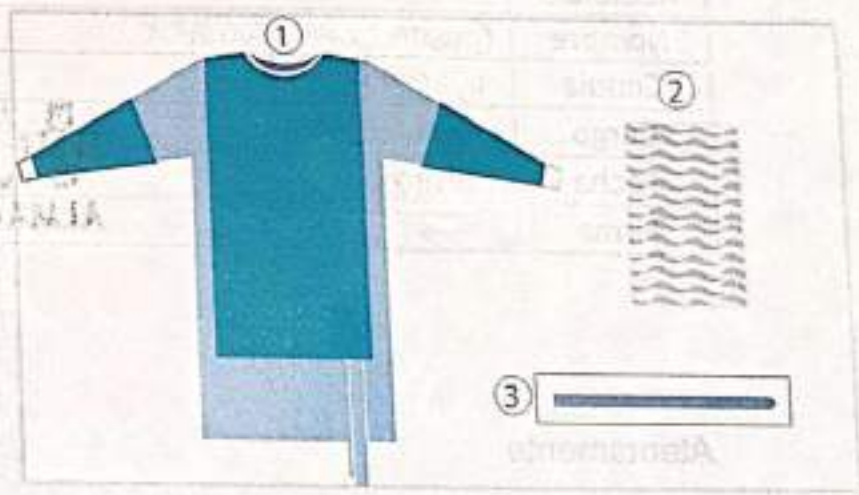

- Adhesivo
- SMS
- Refuerzo
- Absorbente impermeable
- Polietileno azul
- Polietileno transparente
- Tela laminada



CALDAS MEDICAS SAS

890.806.147-3

Carrera 24 # 47-74

ventas@caldasmedicas.com

Telefono:8859134 – Telefax :8859878

Manizales-Caldas

Manizales, julio 01 de 2020

Señores
ESE HOSPITAL FELIPE SUAREZ
Salamina – Caldas.

ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX basic A
SERIAL #	560042-M20107690015

RECIBIDO	
Nombre	CRISTINA CAMILO RODRIGUEZ
Cedula	101992125
Cargo	ALMACENISTA
Fecha	01/07/2020
Firma	

Hospital Departamental Felipe Suarez E.S.E.
Su salud, nuestra razón de ser
ALMACÉN CENTRAL

Atentamente

CECILIA GOMEZ G
Gerente

DESCRIPCIÓN TÉCNICA


NOMBRE COMERCIAL:	KIT DESECHABLE ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización 25 x 33
EMBALAJE:	Caja x 70 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011814
RIESGO:	Clase 1
MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN:	Oxido De Etileno
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases causticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 09 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.

Es un producto diseñado para realizar el cambio de vestuario en los pacientes para las diferentes áreas, en procedimientos quirúrgicos, permitiendo protección e higiene en su presentación.

Uso: Protege el paciente de toda contaminación y conserva la dignidad del usuario.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	BATA MANGA JAPONESA T-L MTDA NO ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 30 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa polipropileno de 11x16 C1.2 por 10 unidades
EMBALAJE:	Caja x 300 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	N/A Según decreto 4725 del 2005
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	N/A
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001 en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de agua y saneamiento.

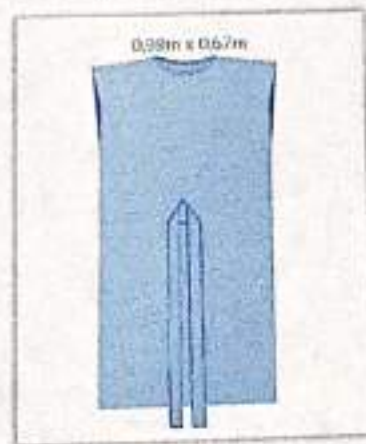



FICHA TECNICA ROPA DESECHABLE

Código: FT-01-010-L

Versión: 01

Fecha: 02/09/2020

LER PREVENCIÓN

DEPARTAMENTO: DIRECCION TECNICA

FICHA TECNICA BATA QUIRURGICA DESECHABLE

1. DATOS GENERALES

NOMBRE GENERICO:	BATA QUIRURGICA DESECHABLE SMS 40		
NOMBRE COMERCIAL:	BATA LAMINADA NO ESTERIL	MATERIAL DE FABRICACION:	SMS 40GR
PRODUCTO NACIONAL:	SI	TIPO/GRADO:	DESECHABLE
PRODUCTO IMPORTADO:	NO	CODIGO DE BARRAS(EAN 13)	N/A
PRODUCTO ESTERIL:	NO	VIDA UTIL DEL PRODUCTO	5 AÑOS
PRODUCTO GRAVADO IVA	NO	COLOR	AZUL
REGISTRO SANITARIO NO.	NO REQUIERE	VIGENCIA DE REGISTRO SAN	N/A



2. DATOS DE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO:	MANTENGASE EN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y SECO					
CLASIFICACION DEL RIESGO	N/A		EL PRODUCTO ES REUTILIZABLE	NO		
TALLA/MEDIDA:	UNICA		ANCHO MANGA:	32 cms	CALIBRE:	35-40GR
LARGO:	110 cms		LARGO MANGA	60cms	PRESENTACION	Paq X 10
ANCHO:	140 cms		TIPO DE TELA BASE:	SMS	TELA COMPLEM.	Puño poliester blanco

3. DATOS TECNICOS DEL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO

BATA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO ELABORADA EN TELA SMS ANTIFLUJO DE 40 GRS CON DOS TIRAS DE AMARRE

BATA QUIRURGICA ESTANDAR CON TIRAS DE AMARRE, PUÑO BLANCO EN ALGODÓN RESISTENTE A FLUIDOS

TELA NO TEJIDA SMS TELA , HILAZA

4. INDICACIONES Y USOS

BRINDA PROTECCION DURANTE PROCESOS MEDICOS , PROTEJE AL PERSONAL DE LA EXPOSICION A ENFERMEDADES Y MATERIALES PELIGROSOS

NO TRANSPARENTE, LO CUAL BRINDA UN EXCELENTE CONFORT, SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA PUÑO BLANCO

REVISÓ: LUIS EDUARDO ROJAS
A CARGO: DAVID DUARTE

APROBO: MYRIAM DUENAS

EASY FACE PROTECTOR

Caretas de Protección facial


USOS:



- Medico
- Dental
- Laboratorios
- Industrial
- Alimentos
- Supermercados
- Aseo
- Doméstico.



ESPECIFICACIONES

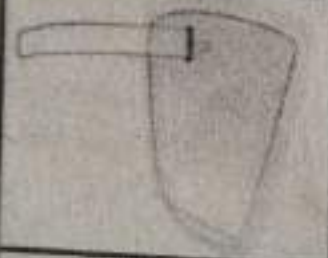

Visor en **PET G** a prueba de salpicaduras, doble cara, antiempañamiento, antiarañados, fuerte resistencia a ácidos y alcalinos.

Estructura adaptable para trabajadores de varios tipos, puede cubrir directamente las gafas de trabajador.

Puede evitar efectivamente infecciones del personal médico causado por fluidos corporales.

Amplia cobertura protectora.

Ligero, diseño ergonómico, cómodo para usar sin sensación de presión.

Doble película protectora en el visor para garantizar asepsia del producto antes del primer uso.



COMPONENTES	MATERIAL	PESO	ESPESES	DIMENSIONES
Visor	PETG		0.75mm	39x23cm
cinta	Polipropileno	66 gr	Calibre 30	70x3 cm
UNIDAD DE EMPAQUE	TAMANO BOLSA	MASTIL PCK	TAMANO MASTIL PCK	PESO MASTIL PCK
Bolsa x und	A: 28 cm L: 44 cm	Caja de 25 unidades	H: 20 cm L: 43 cm A: 26 cm	1.0 kg WPOX.



ADVERTENCIA

- Para mayor durabilidad limpie preferiblemente con paño húmedo con agua o limpiavidrios o lave con agua y jabón de tocador.
- Seque con paño seco suave.
- Nunca limpie con elementos o productos abrasivos ni con ningún solvente o químico.
- Para conservar condiciones de asepsia limpie siempre antes de usar y si es de uso continuo por lo menos cada tres horas.

PROPIEDADES PET G

El **PET G** tiene un aditivo adicional (GLICOL) que hace que el **PET G** sea más transparente, más resistente y más flexible en comparación al **PET**.



Buena propiedades ópticas



Excepcionales propiedades a altas temperaturas



Superficie brillante y scratchless



Muy buena resistencia a agentes químicos



Alta resistencia al impacto



Baja absorción de agua



Fácil reciclaje



Excelente resistencia al fuego **BS200**

PROPIEDADES POLIPROPILENO

Aplicaciones:

- Vehículos automotores, espejos, jantes, partes plásticas
- Películas para agricultura de invernadero
- Cintas industriales (cintas planas)
- Bolsas, cables, contenedores, tuberías para líquidos
- Bases de lavavajillas, cajas de batería, partes de TV y computadoras
- Cables para regar jardines

Aplicación y Estabilidad:

- Impermeable a los aceites
- Inerte
- Químico
- Transparente en películas
- Resistente a la abrasión
- Impermeable
- No tóxico
- Resistente a la intemperie (UVB)

PROPIEDAD INTELECTUAL DE DSP - FACTORY S.A.S.
Este producto es una propiedad intelectual y se encuentra en proceso patente de diseño y registro de marca ante la autoridad competente de México y Colombia. Su reproducción, uso parcial, copia o cualquier otro acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual de DSP - FACTORY S.A.S. quedan expresamente prohibidos.



FICHA TÉCNICA MASCARILLAS ANTIFLUX MB85 GENIO /AVL Maxlife

Code: FT-31-03 Date: 10/2020 Versión: 03

GENERALIDADES:

PRODUCTO
SERIE
REFERENCIA
DESCRIPCIÓN



Mascarillas / tapabocas de tres capas uso médico.

Telas no tejidas termoselladas

MB – con filtro Mel Brown

Mascarilla quirúrgica fabricada con 85 g/m² de telas no tejidas a base de polipropileno aptas para el contacto con la piel lo cual ofrece una textura suave. Cuenta con tres capas de telas no tejidas para mayor protección, la capa externa es antfluida y protege de fluidos externos e internos, la capa de medio actúa como filtro principal y la capa interna ofrece confort. Está diseñada para proteger las vías respiratorias y gran parte del rostro. Cumple la norma técnica NTC 1733 Higiene y Seguridad Equipos de protección respiratoria requisitos generales norma española UNE-EN 14683:2019 + AC para mascarillas quirúrgicas requisitos y métodos de ensayo. La mascarilla es estable frente a patógenos. Autorización del INVIMA para la "Fabricación comercialización de dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico" Registro 166 – 0 2804 – 2020 según resolución 522 de 2020.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

La mascarilla cuenta con las siguientes especificaciones:

Cumplimiento de norma
Eficacia de filtración bacteriana
Forma
Largo
Ancho
Ajustador nasal
Número de capas
Tipo de Filtro
Referencia de telas no tejidas
Antifluidas
Densidad de fibra total
Plegues
Clásico
Proceso productivo

NTC 1733 para mascarillas quirúrgicas

= 95% (BFE)

Rectangular

17,5 cm +/- 0,5 cm

9,5 cm +/- 0,5 cm

min 8,0 cm

Tres capas de telas no tejidas con filtro

Melbrown

Sounbond de Polipropileno


Repeencia al agua -90 norma AATCCM22

min 85 g/m² en tres capas

Tres pliegues faciales

Banda elástica blanca, en cada lado

Sistema automático termosellado con ultrasonido



ORIGEN, EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

Nuestras mascarillas Antiflux MB85 son fabricadas en Colombia bajo las marcas comerciales Genio y AVL Maxlife, tienen empaque individual, en cajas de 50 unidades. En una caja master se empaquetan 48 cajas, es decir 2400 unidades. Se debe almacenar en lugares frescos, secos y libres de contaminación. Se debe desechar el tapaboca y el empaque de forma adecuada, siguiendo los protocolos de bioseguridad.



FICHA TÉCNICA MASCARILLAS ANTIFLUX MB85 GENIO /AVL Maxlife

Code: FT-31-03 Date: 10/2020 Versión: 03

APLICACIONES

La mascarilla es usada para la protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire y protege a las personas de fluidos que vayan hacia o desde las vías respiratorias. Es de suave textura y buena respirabilidad cumpliendo la norma técnica Colombiana NTC 1733.

INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

Antes de tocar un tapabocas limpio: Debes lavarte las manos muy bien con agua y jabón. Una vez que hayas aplicado el jabón en tus manos húmedas, frótelas para lavartas durante al menos 20 segundos antes de enjuagarlas. Siempre usa una toalla limpia para secarte las manos y, luego ponla en un contenedor de basura.


Orienta la parte superior del tapabocas correctamente: Para que el tapabocas quede lo más cerca posible de tu piel, ten en cuenta que la parte superior del mismo tiene un borde flexible, pero rígido, en alambre, en alambre, que puedes moldear alrededor de tu nariz. Cerciorate que ese lado esté orientado hacia arriba antes de colocarte el tapabocas.

Asegurate que el lado correcto del tapabocas quede hacia afuera. Los fuertes nasales deben quedar hacia arriba en la parte interna, y hacia abajo en la parte externa. Ponse el tapabocas en la cara: Con bandas para las orejas: Algunos tapabocas tienen dos bandas para colocar en cada una de las orejas. Por lo general, estas bandas se hacen de un material elástico para que puedan estirarse. Agarra este tipo de tapabocas por las bandas, ponlas alrededor de tus orejas.

Ajusta la pieza que va en la nariz: Ahora que el tapabocas está en su lugar en la cabeza y la cara, usa el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible de su borde superior, alrededor del puente de la nariz. Ajusta el tapabocas en tu cara y debajo de tu barbilla: Una vez que el tapabocas esté totalmente asegurado, acomódalo para que te cubra la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de tu barbilla.

Quitate el tapabocas con mucho cuidado: Retíralo solamente tocando los bordes, las correas, los lazos, las ataduras o las bandas. No toques la parte frontal debido a que podría estar contaminada. Quitate el tapabocas de forma segura y procede a lavarlo con agua y jabón o detergente, o procede a desecharlo. En ambientes médicos es probable que haya un cubo de basura específico para elementos de riesgo biológico como tapabocas y guantes usados. En un ambiente no médico donde un tapabocas podría contaminarse de todos modos, debes colocarlo dentro de una bolsa plástica. Amarra la bolsa para cerrarla y luego arroja al cubo de la basura.

Lávate las manos otra vez: Una vez que hayas desechado el tapabocas de forma segura, lávate las manos nuevamente para asegurarte de que están limpias y no se hayan contaminado al tocar el tapabocas sucio.

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-15	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2015	Página 1 de 3

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Bianco - Negro - Azul - Verde

2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Polipropileno
Nanguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance de respirador	Poliéster - Caucho

3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO


3.1. Instrucciones de uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total efectividad, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revisar que el respirador se encuentre en buenas condiciones.
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza localizando una en la coronilla y otra en la nuca.

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-15	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2015	Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas.
Inodoro	El material de las telas no contiene formaldehído.
Ajuste perfecto en el tabique	Lamina en el área de la nanguera para realizar el ajuste.

4. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de sentido de flujo	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de Inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Optimización de Uso	Hermeticidad	NITTA

5. PRESENTACIÓN


El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empaquetado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado:

JOSE PABLO GARCIA
DIRECTOR DE CALIDAD

GERARDO LÓPEZ
ASISTENTE DE CALIDAD

1ª Revisión 04 Fecha Mayo 26 de 2015

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-15	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2015	Página 1 de 3

PASO	INSTRUCCIÓN
Modelar Nanguera	Modelar la nanguera ajustandola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, No use el respirador

3.2. Condiciones de Uso

PARAMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19.5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fluorados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 ⁶ partículas m ³ TLV-TWA 0.05 mg/m ³
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	= 95%
Resistencia a la inhalación	= 35 mm H ₂ O
Resistencia a la exhalación	= 25 mm H ₂ O

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto de anclaje, que une las telas evitando que se separen.



MASCARILLA QUIRÚRGICA

Termosellada de tres pliegues con elástico.

Materiales

Capa Interna:
Tela no tejida Spunbond blanco 25 GSM

Capa Central:
Tela no tejida Meltblown 25 GSM

Capa Externa:
Tela no tejida Spunbond Azul 25 GSM

Elástico libre de latex

Ajuste facial

Dimensiones



Largo: $17,5 \pm 0,3$ cm
Ancho: $9,5 \pm 0,3$ cm

Uso

Barrera de contacto con fluidos corporales, con el fin de prevenir infecciones.

Usar una (1) sola vez.

Desechar en sitios señalizados.

Empaque

Caja Master:
40 Unids. (Cajas Individuales)

Caja individual:
50 Unids. (Tapabocas.)

2.000 Tapabocas

Almacenamiento

Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 10° y 34°C ; evitar contacto directo con la luz.

5 años de vida útil.

Características

Alta capacidad de filtración bacteriana.

Excelente ventilación y respirabilidad.

Firmeza y seguridad en el sellado de los elásticos.

Tela hipoaérgica.

¿Está listo para protegerse correctamente?
Realice su pedido.



✉ direccionbhq@gmail.com

Call: 310 26 335 - Medellín
Bodega MI-1, Matronarque
Barranquilla - Colombia



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Versión: 00
Fecha emisión: 8/5/2020
Codigo: FTMF-003
Página: 1 de 1

Codigo:	T001
Producto:	Mascarilla quirurgica termosellada de tres pliegues con elástico
Color:	Interior Blanco/ Exterior Azul
Marca:	4B:



Descripción: Mascarilla Facial termosellada de tres pliegues con elástico para sujeción a la oreja

Material:

Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster
Capa Interna: Tela no tejida Spunbond blanco 25 GSM
Capa Central: Tela no tejida Meltblown 25 GSM
Capa Externa: Tela no tejida Spunbond Azul 25 GSM
Elástico libre de latex
Ajuste facial

Dimensiones:

Dimensiones que cubren perfectamente las entradas a las vías respiratorias
Largo: $17,5 \pm 0,3$ cm
Ancho: $9,5 \pm 0,3$ cm

Eficacia de filtración del material filtrante

BFE $\geq 95\%$.

Uso:

Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire con el fin de evitar infecciones. Se usa en el campo médico, odontológico y quirúrgico.

Apariencia:

Libre de partículas, sin olor.

Condiciones de almacenamiento:

Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 10° a 34°C ; evitar contacto directo con la luz

Inscripción Invima:

38166

Presentación:

Caja x 50 unidades

Nivel de Riesgo:

I

Vida útil:


5 años

Origen:

100% Fabricación nacional

GUANTE DE LATEX ESTERIL WELL

Nombre comercial:	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL	Composición:	N/A
Materia:	LÁTEX NATURAL	Presentación:	CAJA X 50 PARES
Dimensiones:	N/A	Peso:	N/A
Marca:	WELL CARE	Referencia:	MD-GU1089; MD-GU1199; MD-GU1391; MD-GU1200; MD-PR5805

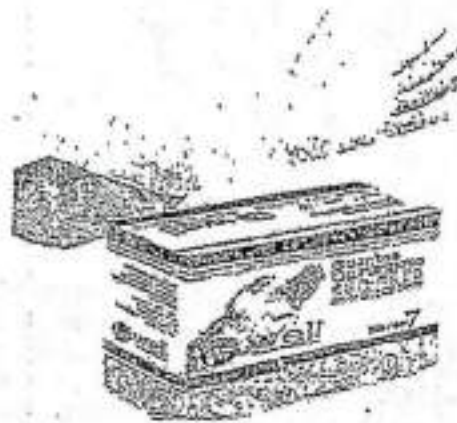

ESPECIFICACIONES

- Registro Sanitario: INVIMA 2014DM-0011686.
- Vencimiento registro sanitario: 2024/07/30
- Clasificación según el INVIMA: Dispositivo médico riesgo IIA.
- Código ATC: No aplica por ser dispositivo médico.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en látex natural.
- Bajo potencial alergénico.
- Con borde reforzado.
- Baja concentración de talco.
- Cómoda manipulación, precisa y de gran sensibilidad táctil.
- Esterilizados en rayos gamma.

RECOMENDACIONES

- Para conservar la integridad del guante se recomienda no almacenarlos a altas temperaturas ni en presencia de radiaciones.
- No se aplicarán cremas antes de colocarse los guantes, ya que pueden alterar las propiedades del mismo. Este es un

MONOGAFA DE SEGURIDAD VENTILACIÓN INDIRECTA



DESCRIPCIÓN

Las monogafas de protección ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo en especial proyección de partículas líquidas y sólidas en gran cantidad. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.

Todas nuestras monogafas están elaboradas en policarbonato de alta calidad y cumpliendo con Normatividad Internacional.

APLICACIONES

La Monogafa de Seguridad aplica para toda las actividades industriales que generen altas concentraciones de material particulado o proyecciones de partículas líquidas. Refinación

- Exploración • Explotación • Producción • Transporte • Alimentos • Agricultura Logística
- Almacenamiento • Mantenimiento • Ambiental • Puertos marítimos • Farmacéutica • Forestal
- Fuerzas Militares • Aeronáuticas • Ensambladoras • Pesqueras • Minería • Construcción
- Supervisión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monogafa de cuerpo en PVC I de alta flexibilidad.

Monolente de policarbonato de 2,0mm de grosor

- Monolente con tratamiento anti-empañante (AF).
- Marco con orificios de ventilación indirecta en la parte superior.
- Resistencia a salpicaduras, impactos de alta velocidad e ignición
- Ensamble sin partes metálicas (no conductor)
- Banda elástica negra para ajuste de 13mm
- Ofrece buen sello y ajuste al rostro
- Diseño ergonómico
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6
- Peso 75,5g
- Certificado ANSI Z87.1-2015

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas. Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.
- Esta monogafa es adecuada para proteger contra salpicaduras e impacto
- Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda otros tipo de monogafa.
-
- **LIMPIEZA:**
- Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

REFERENCIA

Lente Claro

USOS

Monogafa Clara permite la trasmisión de luz máxima en actividades internas o espacios cerrados.

EMPAQUE

Unitario



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE





VERSIÓN 7

Código: 00-MS-F

PÁGINA 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
27-02-21	Lavandera	Aux. S.G	Alfonso Campo	Tapabocas	Bueno	11:00	N 95
27-02-21	Comerena III	Aux. S.G	Bibiana Guantes	Tapabocas	Bueno	11:07	N 95
27-02-21	Lavandera	Aux. S.G	Karla Cecilia Alvarado	Tapabocas	Bueno	11:05	N 95
27-02-21	Lavandera	Aux. S.G	Nancy Arroyo	Tapabocas	Bueno	11:03	
28-02-21	CEREA	COMEDANTE	Luis Bermudez	Tapabocas	Bueno	11:15	
28-02-21	CEREA	CUSCO	Dijonany Morán	Tapabocas	Bueno	11:15	N 95
28-02-21	Asistencia	Asistente	Carla Calderon	Tapabocas	Bueno	11:40	
28-02-21	Comedor	Asistente	Alfonso Campo	Tapabocas	Bueno	12:00	
NIVEL DE RIESGO				DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO	
TOTAL TRABAJADORES							Servicios generados, Cordero. Archivo.

Dirección: Calle 3ª N° 9 A-21, Salamina Caldas. Telefonos: 8595192-8595196 Telefax: 8595306
 Pagina Web: www.msfelipe Suarez.gov.co
 E-mail: correspondencia@esfelfelipe Suarez.gov.co

		GESTION DOCUMENTAL FORMATO ENTREGA DE EPP HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE							VERSION: Código de MSA: PAG. 1 DE 1
Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones		
22-02-2021	P.Y.P	Aux - Enferm.	Ange Dojerna Cruz.	Tapabocas					
22-02-2021	P.Y.P	Aux - Enferm.	Yelm Natalia B.	Tapabocas					
22-02-2021	P.Y.P	AUXILIAR DE ENFERMERIA	YELM Natalia B.	Tapabocas	BUENO				
22-02-2021	P.Y.P	AUXILIAR DE ENFERMERIA	YELM Natalia B.	Tapabocas	BUENO				
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO		INDIRECTO		INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES						PYP			

Dirección: Calle 3ª N°. 9-A, 11, Salamina Caldas. Teléfonos: 8595192-8595196 Telefax 8595306
 Página Web: www.esf.felipe Suarez.gov.co
 E-mail: correspondencia@esf.felipe Suarez.gov.co



GESTION DOCUMENTAL
FORMATO ENTREGA DE EPP
HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE



Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
15/02/21			Josue Hernandez	Guantes	Bueno		
16/02/21			Josue Hernandez	Guantes	Bueno		
17/02/21			Josue Hernandez	Guantes	Bueno		
18/02/21			Josue Hernandez	Guantes	Bueno		
19/02/21			Josue Hernandez	Guantes	Bueno		
NIVEL DE RIESGO							INTERMEDIO
TOTAL TRABAJADORES							25



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP



VERSIÓN 2

Código: GD: HSP.F

PÁG: 1 DE 1

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ ESE

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
15/02-21	HOSPITALIZACIÓN	SUPERVISOR	Fernando Montaño	Topa Bosch	Bueno	7:20 AM	
			Lucel Barner			7:20 AM	
			Jessica Naranjo			7:20 AM	
			Manuela Osorio			7:20 AM	
			Karen Cardenas			7:20 AM	
16/02-21			Jenny Lizette			7:20 AM	
			Manuela Osorio			7:20 AM	
			Jenny Lizette			7:20 AM	
17/02-21			Manuela Osorio			7:20 AM	
			Jenny Lizette			7:20 AM	
			Manuela Osorio			7:20 AM	
18/02-21			Jenny Lizette			7:20 AM	
			Manuela Osorio			7:20 AM	
19/02-21			Jenny Lizette			7:20 AM	
20/02-21			Jenny Lizette			7:20 AM	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES		30					

Dirección: Calle 3ª Nº. 9 A - 21 - Salamina Caldas. Telefonos: 8595192-8595196 Telefax 8595306
 Página Web: www.esefelipesuarez.gov.co
 E-mail: correspondencia@esefelipesuarez.gov.co

107
 98
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300



FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ ESE

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
15-02-21	Farmacología	Farmacología	Festy Aguirre Dorado	Tapabocas	Bueno	11:00	N-95
15-02-21	Lavandería	Aux. S. G.	F. Amparo Campo	Tapabocas	Bueno	11:00	N-95
15-02-21	Emergen	Aux. S. G.	Pubertha Cuentras	Tapabocas	Bueno	11:02	
15-02-21	Química	Aux. S. G.	Maria Caroly Moya	Tapabocas	Bueno	11:05	N-95
15-02-21	Química	Aux. S. G.	Blanca Arriaza	Tapabocas	Bueno	11:05	
15-02-21	Cafetería	Cocinera	Zuz Garmida	Tapabocas	Bueno	11:15	
15-02-21	Cafetería	Auxiliar	Alicenda Amado	Tapabocas	Bueno	11:15	
15-02-21	Archivos	Auxiliar	Cecilia Soto	Tapabocas	Bueno	11:00	
15-02-2021	Química PYP	Aux. S. G.	Germán Berrío	Tapabocas	Bueno	3:57	
15-02-21	Química	Aux. S. G.	Pablo de la Cruz	Tapabocas	Bueno	8:57	
16-02-21	PYP	Aux. S. G.	Tatiana Viquez	Tapabocas	Bueno	8:10	N-95
17-02-21	Química	Aux. Enf.	Abdulacio Aragón	Tapabocas	Bueno	8:00	N-95
NIVEL DE RIESGO							
TOTAL TRABAJADORES							
				DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO	

Servicios generales, higienización
cañales.

Dirección: Calle 3ª No. 9A-21. Salamina Caldas. Teléfonos: 8595102-8595136. Telefax: 8595306

Página Web: www.eosfelipe Suarez.gov.co

E-mail: correspondencia@eosfelipe Suarez.gov.co

		GESTION DOCUMENTAL FORMATO ENTREGA DE EPP HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE							VERSIÓN 2 Código: 00-MS-P PÁGINA 1 DE 1
Fecha	Área	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones		
16-02-21	U16	conductor	Juan Pablo	Tapabusto	Buena	11:00			
16-02-21	U16	Portero	Heriberto Manríquez	Tapabusto	Buena	"			
"	U16	AUX. ENF	Yubiana Ayulo	PQS	Buena	"			
"	U16	conductor	Kylen Mueya	Tapabusto	Buena	"			
"	U16	conductor	Blasuyo Cardona	Tapabusto	Buena	"			
"	U16	conductor	Fernando Langar	Tapabusto	Buena	"			
17-02-21	U16	Aux. Enf	Daniel Latino	PQS	Buena	"			
"	U16	Med. Int	Kayo Ballerín	Tapabusto	Buena	"			
"	U16	Med. General	Enrique Guerra	Tap. PQS	Buena	"			
"	"	Med. General	Angela Bohero	Tap. PQS	Buena	"			
"	"	AUX. ENF	Olivia Amador	PQS	Buena	"			
"	"	Portero	German Cabrera	Tapabusto	Buena	"			
18-02-21	"	Portero	Nelson Cano	Tapabusto	Buena	"			
18-02-21	"	Portero	Ornela Hamín	Tapabusto	Buena	"			
18-02-21	"	AUX. ENF	Arduina Ordoña	PQS	Buena	"			
"	"	AUX. ENF	Arveling Cardona	PQS	Buena	"			
"	"	AUX. ENF	Arledy Mejía	PQS	Buena	"			
"	"	AUX. ENF	Paula Gallego	PQS	Buena	"			
"	"	AUX. ENF	Johanna Llanusa	PQS	Buena	"			
"	"	AUX. ENF	Estefania Cano	PQS	Buena	"			
"	U16	enfermera	Xiomara Maya	Tapabusto	Buena	"			
"	"	Factorador	Wanda Heredia	Tapabusto	Buena	"			
"	"	Referencia	Lulima Alvaréz	Tapabusto	Buena	"			
"	U16	H. SOS	Lidia Cardona	Tapabusto	Buena	"			
"	U16	H. SOS	Yatelméne Guadalupe	Tapabusto	Buena	"			
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO					
TOTAL TRABAJADORES		24							

Dirección: Calle 3ª No. 5-A-21, Sanana Caidas. Telefonos: 8595192-8595196 Telefax: 8595306
 Página Web: www.esfeposurez.gov.co
 E-mail: correspondencia@esfeposurez.gov.co


HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2020/10/16

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
MEDICAMENTOS				
05 SEVORANE X 250 ML	UNI	5	385,000.00	1,925,000.00
				1,925,000.00
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO				
0102894 ADAPTADOR DE OXIGENO	UNI	1	46,400.00	46,400.00
0102324 AGUA OXIGENADA GALÓN	UNI	2	45,000.00	90,000.00
0102005 AGUJA HIPODERMICA	UNI	1,700	96.85	164,655.20
0102752 AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 25	UNI	150	8,925.00	1,338,750.00
0102011 ALCOHOL ANTISEPTICO X 750	UNI	69	4,500.00	310,500.00
0102012 ALCOHOL GLICERINADO GEL ANTIBACTERIAL	UNI	20	24,000.00	480,000.00
0102003 ALGODON TIPO HOSPITALARIO	BOL	11	10,800.00	118,800.00
0102550 ALGODONERA	UNI	6	29,750.00	178,500.00
0102013 APLICADORES X 100	PAQ	8	4,291.27	34,330.22
0102014 BAJALENGUAS X 100	CAJ	8	5,212.50	41,700.00
0112083 BATA PACIENTE EN GENERO	UNI	150	2,500.00	375,000.00
0102366 BATA QUIRURGICA DESECHABLE MANGA LARGA	UNI	240	6,500.00	1,560,000.00
0102576 BISTURY CUCHILLA N. 20 - 15	UNI	600	386.75	232,050.00
0102753 BOLSA PARA RESERVORIO DE AMBU	UNI	3	17,255.00	51,765.00
0102453 BONZYME - DETERGENTE MULTIENZIMATICO	UNI	6	38,000.00	228,000.00
0102488 BRAZALETE TENSIOMETRO DE 2 VIAS ADULTO	UNI	4	20,825.00	83,300.00
0102896 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE	UNI	3	35,300.00	105,900.00
0102283 CANULA NASAL OXIGENO ADULTO	UNI	50	1,750.00	87,500.00
0102021 CANULAS DE GUEDELL ADULTA Y PEDIATRICA	UNI	6	1,600.00	9,600.00
0102027 CAT CUT CROMADO 0,1,2/0,3/0,4/0	UNI	30	8,500.00	255,000.00
0102028 CAT GUT SIMPLE 2/0	UNI	12	8,500.00	102,000.00
0102037 CIDEX	UNI	2	225,000.00	450,000.00
0102657 CIDEX OPA 4 GALON	UNI	12	29,000.00	348,000.00
0102654 CLIP UMBILICAL DESECHABLE	UNI	50	892.50	44,625.00
0102041 DRENES DE PENROSE	UNI	6	17,255.00	103,530.00
0102374 ELECTRODO REHUSABLE PARA TEES PAQUETE X 4	UNI	5	25,000.00	125,000.00
0102302 ELECTRODOS DESECHABLES PAQ. X 50 3M	UNU	2	17,500.00	35,000.00
0102754 ELECTRODOS PARA DEA	UNI	1	225,000.00	225,000.00
0102038 ENMASCARAR CINTA PARA ESTERILIZAR	UNI	3	15,870.83	47,612.50
0102044 EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL	UNI	1	61,880.00	61,880.00
0102608 EQUIPO JACKSON	UNI	5	65,000.00	325,000.00
0102046 ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO	ROL	3	49,499.30	148,497.91
0103148 ESPECULO PARA OTOSCOPIO	UNI	1	11,305.00	11,305.00
0102277 ESTERILIZAR BOLSA 135 X 280	UNI	1	105,000.00	105,000.00
0102279 ESTERILIZAR BOLSA MEDIANA	UNI	3	45,000.00	135,000.00
0102280 ESTERILIZAR BOLSA PEQUEÑA CAJA X 200	UNI	2	26,500.00	53,000.00
0102047 FIJADOR PARA CITOLOGIA	UNI	2	14,875.00	29,750.00


HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2020/10/16

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	
01021005	FORMOL X 500 ML	UNI	4	10,621.00	42,484.00
01021016	FORMULA 55X - (QUATERZAN)	UNI	2	75,833.33	151,666.66
0102405	GAFAS SEGURIDAD AJUSTABLES	UNI	4	9,500.00	38,000.00
0102048	GASA TIPO HOSPITALARIO	ROL	10	54,000.00	540,000.00
01020690	GEL PARA ELECTRO GALON	UNI	1	27,500.00	27,500.00
0102049	GLICERINA	UNI	2	10,115.00	20,230.00
0102050	GORROS DESECHABLES	UNI	500	450.00	225,000.00
0102051	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN	UNI	131	32,592.85	4,269,663.87
0102052	GUANTES ESTERILES	PAR	1,200	1,150.00	1,380,000.00
0102607	HEMOSTATICO ABSORBIBLE 3.5	UNI	2	19,500.00	39,000.00
0102921	HEMOSTATICO ABSORVIBLE CELULOSO 10X5.1CM	UNI	3	19,500.00	58,500.00
0102789	HEMOVACK 1/4, 1/8	UNI	6	43,845.83	263,075.00
0102397	INCENTIVO RESPIRATORIO HUDSON I BOLA	UNI	5	25,000.00	125,000.00
0102437	INDICADOR QUIMICO STERIS	UNI	1	101,150.00	101,150.00
0102330	INHALOCAMARA ADULTO NACIONAL	UNI	10	10,500.00	105,000.00
0102054	ISODINE ESPUMA	GLN	1	59,500.00	59,500.00
0102055	ISODINE SOLUCION	GLN	1	59,500.00	59,500.00
0102476	JABON QUIRURGICO GALÓN	UNI	4	29,500.00	118,000.00
0102234	KIT DE TENSIOMETRO Y FONENDO WANSUN	UNI	6	63,708.33	382,250.00
0102146	LAPIZ PARA ELECTRO	UNI	30	11,305.00	339,150.00
0102427	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLES	UNI	50	2,500.00	125,000.00
0102059	MALLA DE POLIPROPILENO (30 X 30)	UNI	1	365,000.00	365,000.00
0102162	MANGUERA CON FILTRO PARA EVACUADOR DE	UNI	1	255,850.00	255,850.00
0102867	MANTA TERMICA	UNI	24	12,500.00	300,000.00
0102260	MASCARA LARINGEA N. 4	UNI	1	65,000.00	65,000.00
0102069	MICROPORE 1"	ROL	16	3,400.00	54,400.00
0102070	MICROPORE 2"	ROL	15	6,800.00	102,000.00
0102071	MICROPORE X 3"	ROL	9	10,200.00	91,800.00
0102072	NIPLE	UNI	4	2,975.00	11,900.00
0102586	NITROFURAZONA 500GR	UNI	7	75,000.00	525,000.00
0102592	PAPEL CRAPADO MEDIO ROLLO 100 METROS	UNI	1	96,002.77	96,002.77
0102074	PAPEL MONITOR FETAL	UNI	2	16,645.00	33,290.00
0102075	PAPEL PARA DESFIBRILADOR	RLO	4	14,875.00	59,500.00
0102177	PAPEL PARA ELECTRO 63X30	UNI	2	8,925.00	17,850.00
0102469	PAPEL PARA ELECTRO 80 MM	UNI	5	6,902.00	34,510.00
0102076	PAPEL PARA ELECTRO Z	UNI	8	10,115.00	80,920.00
0102346	PERAS CON VALVULA PARA TENSIOMETRO	UNI	3	14,875.00	44,625.00
0102080	PLACAS ELECTROBISTURI	UNI	15	11,305.00	169,575.00
0102081	POLAINAS DESECHABLES	UNI	200	950.00	190,000.00
0102756	POLIPROPYLENE 0, 1, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0	UNI	207	9,500.00	1,966,500.00
0102139	PREPODYNE SCRUB BOLSA X 850 CC	UNI	8	27,000.00	216,000.00


HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2020/10/16

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	
0102418	SABANAS RESORTADAS DESECHABLES	UNI	20	2,853.65	57,073.08
0102478	SEDA 2/0 REF. 654	UNI	58	8,500.00	493,000.00
0102479	SEDA 3/0 75CM 16MM	UNI	22	3,000.00	66,000.00
0102090	SEDA SUTURA 0	UNI	5	8,500.00	42,500.00
0102893	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO	UNI	2	155,000.00	310,000.00
0103263	TAPABOCAS N-95 X UNIDAD	UNI	98	5,618.77	550,639.56
0102281	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL LORD	UNI	5	12,500.00	62,500.00
0102339	THERABAN GRIS	UNI	2	10,400.00	20,800.00
0102579	TIJERA MAYO 14.5 CMS HOSPITAL RECTA	UNI	2	12,028.00	24,056.00
0102111	TIRILLAS GLUCOCARD TEST STRIPP	UNI	13	60,000.00	780,000.00
0102901	TORNIQUETE AUTOADHESIVO VELCRO	UNI	3	4,248.30	12,744.90
0102123	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5	UNI	10	2,800.00	28,000.00
0102124	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0	UNI	30	2,800.00	84,000.00
0102125	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5	UNI	30	2,800.00	84,000.00
0102126	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0	UNI	5	2,800.00	14,000.00
0102088	VICRIL 1,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0	UNI	84	9,800.00	823,200.00
					24,743,856.67
REACTIVO LABORATORIO					
0103182	AGAR CROMOGENICO MARCA BBL CAJA X 20	UNI	10	5,200.00	52,000.00
0103006	AGAR MUELLER HINTON X 1	UNI	20	4,500.00	90,000.00
0102458	AGUA DESIONIZADA TAMBOR X 20 LITROS	UNI	2	60,000.00	120,000.00
0103007	AGUJA MULTIPLE 21 X 1 1/2	UNI	27	32,074.69	866,016.87
0103227	AMBELISS POTENSIADOR LISS X 10ML	UNI	1	32,000.00	32,000.00
0103126	AMILASA 405 AA LIQUIDA 3 X 10ML	UNI	1	185,000.00	185,000.00
01030103	ANTI B MONOCLONAL X 10 ML MOVATEC	UNI	2	16,000.00	32,000.00
0103104	ANTI D MONOCLONAL X 10 ML	UNI	1	22,000.00	22,000.00
0103121	CALIBRADOR PLUS 2X 3 ML	UNI	1	425,000.00	425,000.00
0103513	CELULAS I Y II X 5 ML	UNI	1	58,000.00	58,000.00
0103183	CIPROFLAXINA SENSIDISCO FCO X 50	UNI	3	23,000.00	69,000.00
0103025	COLESTEROL HDL DIRECTO CON CALIBRADOR X 80	FCO	1	510,000.00	510,000.00
0103455	CONTROL PARA ORINA 3X8 ML 14 PARAMETROS	UNI	1	115,000.00	115,000.00
0103027	CREATININA 4 X 50ML	UNI	1	120,000.00	120,000.00
0103300	CURITA ADHESIVA CJA X 100	UNI	5	5,600.00	28,000.00
0103032	DESHIDROGENASA LACTICA LHD LIQUIDA X 100 ML	UNI	1	130,000.00	130,000.00
0103029	DILUYENTE X 20 LITROS	UNI	2	275,000.00	550,000.00
0103213	DIMERO D CAJA X 25 DET	UNI	1	375,000.00	375,000.00
0103040	GAMMA GT X 100ML	UNI	1	185,000.00	185,000.00
0103203	HCG PRUEBA RAPIDA CASSETE X 40	UNI	1	40,000.00	40,000.00
0103111	HEPATITIS B X 30 DET	UNI	1	110,000.00	110,000.00
0103700	HIV X 30 PRUEBA RAPIDA STANDARD	UNI	2	125,000.00	250,000.00
0103044	LAMINA CUBRE OBJETOS	CAJ	5	5,355.00	26,775.00


EL SUSCRITO JEFE DE ALMACEN

CERTIFICA

A la fecha contamos en stock los siguientes elementos de protección personal:

ELEMENTO	CANTIDAD
Tapabocas caja x 50 und	394
Tapabocas N95 x unidad	17.485
Guantes des caja x 100	6
Polainas des x unidad	10800
Alcohol antiséptico x 700ml	936
Gorro tipo oruga x 100	12
Bata paciente x unidad	16.200
Bata desechable manga larga x unidad	5.000
Monogafas	7

Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes febrero de 2021

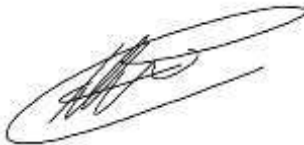

CRISTIAN CAMILO RIOS RIOS
Jefe Central Suministros



EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO SEGURO FRENTE
AL RIESGO BIOLÓGICO COVID-19

Logo empresa

Objetivo: Identificar los comportamientos seguros de los trabajadores en las diferentes áreas relacionados con la prevención del riesgo biológico

Área o servicio: Urgencias

Empresa: HDFS

No	CONDUCTAS	MARQUE CON UNA X			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS COVID 19					
1	Los residuos generados en el área de aislamiento son clasificados como residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso, incluidos los alimentos parcialmente consumidos o sin consumir, material desechable, entre otros.				
2	Los residuos segregados se depositan en doble bolsa roja.				
3	No introduce la mano dentro de recipientes de desechos.				
4	El trabajador encargado de la manipulación de residuos porta EPP de manera permanente: Gorro quirúrgico, guantes, tapabocas, protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo, bata impermeable de manga larga (si la bata no es impermeable, añadir un delantal de plástico), calzado de seguridad.				
5	El trabajador encargado de la recolección de residuos realiza higiene de manos con agua y jabón, antes, durante y después de la manipulación de residuos.				
6	Los elementos y equipos utilizados durante la recolección de residuos son sometidos a limpieza y desinfección de acuerdo a protocolo institucional.				
7	El almacenamiento, transporte y disposición de residuos se realiza en el menor tiempo posible.				
8	El movimiento interno de los residuos generados es diferenciado con respecto al resto de los residuos.				
MANEJO DE ELEMENTOS CORTO PUNZANTES					
1	No recapsula agujas	X			
2	Descarta los elementos cortopunzantes una vez se utilizan en el guardián de seguridad	X			
3	No sobrepasan el límite de capacidad de los guardianes (3/4 partes)	X			
4	No deja elementos corto punzantes en sillas, camas, insertado en los buretroles, mesas.	X			
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD					
1	Realiza higiene de manos en los 5 momentos	X			
2	Realiza higiene de manos con la técnica indicada	X			
3	Manipula pacientes con guantes	X			
4	Toma muestras de laboratorio con guantes	X			
5	Se retira los guantes antes de manipular otros objetos o superficies	X			
6	Manipula ropa contaminada con guantes	X			
7	Recoge la ropa de uso hospitalario y la dispone en bolsa roja en la unidad de atención del paciente			X	
8	Transporta muestras de laboratorio con guantes limpios y en el recipiente de seguridad	X			
9	No consume alimentos ni bebidas en las áreas de trabajo	X			
10	La limpieza de derrames de secreciones, fluidos o sangre se realiza con la técnica indicada	X			
11	Limpia y desinfecta rutinariamente las superficies con las que el paciente está en contacto.	X			
12	Mantiene un registro de todas las personas que ingresan a la habitación del paciente, incluido todo el personal y los visitantes		X		
13	No usa celular, audífonos o marcas libres, en el desarrollo de la prestación de servicios asignados.		X		
14	Cumple el protocolo de aislamiento			X	
15	Si el transporte es requerido, usa rutas de transporte predeterminadas para minimizar la exposición.			X	
16	Para el transporte: Si el paciente que transporta es un caso sospechoso de covid 19, el paciente usa máscara quirúrgica convencional, si se trata de un caso confirmado de covid 19, el paciente usa mascarilla de alta eficiencia N95			X	Hay otro caso para atender sobre el caso covid.

Nº	CONDUCTAS	MARQUE CON UNA X			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO AP.L.A.	
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL COVID 19					
1	Utiliza pertinente y adecuadamente los elementos de protección personal (Gafas, mascarilla N95, bata de bioseguridad limpia, no estéril de manga larga, guantes de látex).	X			
2	No porta elementos de protección individual fuera de las áreas asistenciales	X			
3	Uso del uniforme de acuerdo al protocolo institucional	X			
4	Realiza eliminación adecuada de los EPP desechables (recipiente rojo recubierto con bolsa roja, con tapa de pedal).	X			
5	Realiza higiene de manos antes y después de colocarse los EPP	X			
OBSERVACIONES					
Realizado Por: <u>Andrés Rojas</u> Fecha: <u>17. II. 2021</u>					

Placidia Rojas V.



RESPONSABLE DE LA INSPECCION: *Andrés Rojas*

LIDER DE AREA: *Urgencias*

COMPORTAMIENTO A EVALUAR	CALIDAD					N° Personas observadas	Observación
	0	1	2	3	4		
1 Asepsia	Se realiza el lavado de manos adecuado						
2 Elementos de protección individual	Tiene puesto Gorro desechable, gafas, protector respiratorio y guantes antes de iniciar el procedimiento.						
3 Manejo de dispositivos	Prepara la bandeja o carro de curaciones o de medicamentos para llevar los insumos requeridos para el procedimiento.						
	Le explica al paciente que procedimiento le va a realizar y como lo va hacer						
	Manipula adecuadamente los insumos durante el procedimiento						
	Recoge insumos a dos manos.						
	Antes de usar el guardián, se verifica que se encuentra por debajo de las ¾ partes de su capacidad y que no tenga agujas en la escalerilla.						
	Desecha el cortopunzante inmediatamente se realiza el procedimiento directamente en el guardián y verifican que caiga al fondo del mismo.						
9	Clasifica adecuadamente la basura y deja el área en perfecto orden						

Elaborado por: *Andrés Rojas*

Revisado por: *Coelina Alvarez*

Fecha de revisión: *27-II-2021*

Plaudiatricas V.